

Návod k obsluze

1

OMRON

Automatický měřič krevního tlaku na paži

M7 Intelli IT
s AFib

Před použitím si přečtěte Návody k obsluze 1 a 2.

* Návod k obsluze „2“ následuje v této brožuře za návodem „1“.

CE 0197

All for Healthcare

CZ
Symbole

1. Úvod

Děkujeme vám, že jste si zakoupili automatický měřič krevního tlaku na paži OMRON. Tento měřič krevního tlaku používá oscilometrickou metodu měření krevního tlaku. To znamená, že měřič zjistí průtok krve přes brachální arterii a na základě tohoto pohybu stanovuje digitální hodnotu.

1.1 Bezpečnostní pokyny

Tento návod k obsluze vám poskytuje důležité informace o automatickém měřici krevního tlaku na paži OMRON. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné použití tohoto měřiče, PŘEČTĚTE SI A POCHOpte VŠECHNÝ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY. **Pokud těmto pokynům nerozumíte nebo máte nějaké otázky, kontaktujte předstírní, než se pokusíte tento měřič použít, maloobchodního prodeje nebo distributora společnosti OMRON. Podrobné informace o vašem krevním tlaku vám poskytne váš ošetřující lékař.**

1.2 Účel použití

Tento měřič určený k použití pro měření krevního tlaku a tepové frekvence u dospělých pacientů. Přístroj zjišťuje během měření nepravidelnou srdeční činnost a při zobrazení hodnot vydá varovný signál. Je určen hlavně pro běžné domácí využití.

Přístroj dokáže zjistit nepravidelný puls, který může naznačovat fibraci síní (Afib). Upozorníme, že přístroj není určen k diagnostikování fibrace síní. Diagnózu fibrilace síní lze potvrdit pouze pomocí elektrokardiogramu (EKG). Pokud se zobrazí symbol Afib, obrátte se na lékaře.

1.3 Príjem a kontrola

Vyměte měřič a ostatní součásti z obalu a zkонтrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud jsou měřič nebo některá součást poškozené, NEPOUŽÍVEJTE JE a obrátte se na maloobchodního prodejce nebo distributora společnosti OMRON.

2. Důležité bezpečnostní informace

Předtím, než použijete tento měřič, si přečtěte část Důležité bezpečnostní informace v tomto návodu. Z důvodu bezpečnosti je nutné pozorně doručovat tento návod.

Návod si ponechte pro budoucí použití. Podrobné informace o vašem krevním tlaku vám POSKYTNĚ VÁŠ OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ.

Označuje potenciálně nebezpečné situace, které – pokud jím nezabráňíte – mohou vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

▲ 2.1 Varování

- Nepoužívejte měřič u nemluvnět, batolat, děti nebo osob, které se nedokáží vyjádřit.
- NEUPRAVUJTE si dávky léků na základě hodnot naměřených tímto měřičem krevního tlaku. Užívejte léky tak, jak je předepsal váš lékař. POUZE lékař má kvalifikaci k diagnostice a lečbě vysokého krevního tlaku a fibrilace síní.

- NEPOUŽÍVEJTE měřič na zraněném paži nebo na paži, u které probíhá léčba.
- NENASAZUJTE měřič na paži, pokud je vám aplikována infuze nebo krevní transfuse.
- NEPOUŽÍVEJTE tento měřič v oblastech s vysokofrekvenčním (HF) chirurgickým vybavením, zařízeními pro zobrazení pomocí magnetické rezonance (MRI) či skenery výpočetní tomografie (CT). Mohlo by to způsobit nesprávnou funkci monitoru nebo nepřesné měření.
- NEPOUŽÍVEJTE tento měřič v prostředí s vysokým obsahem kyslíku nebo blízkou hořlavých plynů.
- Pokud trpite běžnou arytmii, jako sínovou nebo komorovou s předčasnými stahy či fibrilací síní, kornatěním tepen, špatným prokrvením, diabetem, onemocněním ledvin, preeklampsii nebo pokud jste tehotná, poraďte se před použitím přístroje s lékařem. UPOZORNĚTE, že kterékoli z těchto potíží a stavů spolu s pohybem, chvěním a svalovým třesem pacienta mohou ovlivnit odečet naměřené hodnoty.
- NIKDY si nestanovujte diagnózu či léčbu na základě vám naměřených hodnot. VŽDY se poraďte se svým lékařem.
- Abi nedošlo k uskrcení, uchovávejte vzduchovou hadičku a kabel sítového adaptéra mimo dosah nemluvnět, batolat a děti.
- Tento produkt obsahuje drobné součásti, které mohou v případě polknutí způsobit udušení nemluvnět, batolat či děti.
- Přenos dat**
 - Tento produkt vyzařuje rádiové frekvence (RF) v pásmu 2,4 GHz.
 - NEPOUŽÍVEJTE tento produkt v místech, kde jsou rádiové frekvencní zařízení zakázána, jako například v letadle nebo v nemocnicích. V místech, kde jsou rádiové frekvencní zařízení zakázána, vypráchněte na měřicí funkci **Bluetooth®** a vyměňte baterie a/nebo odpojte sítový adaptér.
- Sítový adaptér (volitelné příslušenství) – manipulace a použití**
 - Pokud je přístroj nebo kabel sítového adaptéra poškozený, sitový adaptér NEPOUŽÍVEJTE. Pokud je přístroj nebo kabel poškozený, ihned vypněte napájení a sítový adaptér odpojte.
 - Zapojte sítový adaptér do příslušné elektrické zásuvky, NEPOUŽÍVEJTE rozpočovací zásuvky.
 - Sítový adaptér NIJKDY nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokrýma rukama.
 - Sítový adaptér NEROZBÍRETE ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Manipulace s bateriem a jejich použití**
 - Baterie ukládejte mimo dosah nemluvnět, batolat a děti.
 - Označuje potenciálně nebezpečné situace, které – pokud jím nezabráňíte – mohou vést k lehkému nebo středně těžkému zranění uživateli či pacienta nebo k poškození vybavení či jiných předmětů.

- Než měří použijete na paži s intravaskulárním přístupem nebo léčbou či arteriovenózním (A-V) zkratem, poradte se s lékařem. Důvodem je dočasné narušení průtoku krve, které může mít za následek zranění.
- V případě, že ještě podstoupili mastektomii, se před použitím tohoto měřiče poradte s lékařem.
- V případě významných potíží průtoku krve nebo krevních onemocnění se před použitím tohoto měřiče poradte s lékařem, jelikož naftouknutí manžety může způsobit pozmraždění.
- NEPROVÁDĚJTE měření částí, než je nutné, protože vlivem narušení průtoku krve může dojít k pozmražení.
- Manžetu naftujete POUZE tehdy, pokud je umístěna v horní části paže.
- Pokud se manžeta nezáčne během měření vyfukovat, sejměte ji.
- Přístroj se v případě poruchy může začít zahívrat. Pokud k tomu dojde, NEDOTÝKEJTE SE přístroje.
- NEPOUŽÍVEJTE přístroj pro jakýkoli jiný účel než pro měření krevního tlaku a/nebo zjištování možné fibrilace srdce.
- Ujistěte se, že během měření se ve vzdálenosti do 30 cm od přístroje nenachází žádné mobilní zařízení ani jiné elektrické zařízení, které využívá elektromagnetické pole. Mohlo by to způsobit nesprávnou funkci monitoru nebo nepřesné měření.
- Měří nebo jeho další součástí NEROZEBÍREJTE ani se je NEPOKOUŠEJTE OPRAVOVAT. Mohlo by to vést k nepřesnému měření.
- NEPOUŽÍVEJTE měříč v místě, kde se objevuje vlnkost nebo riziko stříknutí vody na tento měříč. Toto může měříč poškodit.
- NEPOUŠTĚTE a NEVYSTAVUJTE silným otřesům nebo vibracím.
- NEPOUŽÍVEJTE tento měříč v místech s vysokou či nízkou vlhkostí nebo vysokými či nízkými teplotami. Přečtěte si kapitolu 6.
- Během měření sledujte paži a zajistěte, aby měříč dlouhodobě nenarušil cirkulaci krve.
- NEPOUŽÍVEJTE tento měříč v místech, kde se předpokládá částé použití, jako například ve zdravotních klinikách nebo lékařských ordinacích.
- NEPOUŽÍVEJTE tento měříč zároveň s dalším zdravotnickým elektrickým zařízením. Mohlo by to způsobit nesprávnou funkci a/nebo nepřesné měření.
- Minimálně 30 minut před provedením měření se vyhněte koupaní, požití alkoholu nebo kofeinu, koulení, cvičení a konzumaci jídla.
- Před zahájením měření minimálně 5 minut odpočívejte.
- Před provedením měření odstraňte z paže těsně přiléhající oděv a věškeré doplňky.
- V průběhu měření zůstaňte v klidu a NEMLUVTE.
- Měří používejte POUZE u osob, jejichž obvod paže je ve specifikovaném rozsahu manžety.

- Před provedením měření zajistěte, aby se měříč aklimatizoval na pokojovou teplotu. Provádění měření po exteriém změně teploty může vést k nepřesnému měření. Pokud byl měříč skladován při maximální nebo minimální skladovací teplotě a chystáte se ho použít v prostředí s teplotním rozsahem specifikovaným jako provozní podmínky, doporučuje společnost OMRON počkat 2 hodiny na jeho zahrátí či zchladnutí. Další informace k provozní a skladovací/transportní teplotě naleznete v kapitole 6.
- NEPOUŽÍVEJTE tento měříč poté, co uplynula jeho doba životnosti. Přečtěte si kapitolu 6.
- Manžetu ani vzduchovou hadičku NADMĚRNĚ NEOHÝBEJTE.
- Během měření vzduchovou hadičku NEOHYBĚJTE A NEKRUJTĚ s ní. Mohlo by dojít k poranění dílu vodu přerušení průtoku krve.
- Chcete-li odpojit vzduchovou zástrčku, zatahněte za plastovou vzduchovou zástrčku v základě hadičky nikoli za hadičku samotnou.
- Používejte POUZE síťový adaptér, manžetu, baterie a příslušenství specifikované pro použití s tímto přístrojem. Používání nepodporovaných síťových adaptérů, manžet a baterií by mohlo vést k poškození přístroje.
- Používejte POUZE manžetu, která byla pro tento přístroj schválena. Použití jiných manžet může mít za následek nesprávně naměřené hodnoty.
- Naftová manžeta na výši než doporučený tlak může vést ke vzniku modřin na paži v místě aplikace manžety. POZNAMKA: Další informace naleznete v části „Je-li vás systolický tlak výšší než 210 mmHg“ v kapitole 13 Návodu k obsluze (2).
- Před likvidací přístroje a věškerého používaného příslušenství nebo volitelných součástí si přečtěte část „Správná likvidace tohoto produktu“ v kapitole 7 a dodržujte uvedené pokyny.

Přenos dat

- NEVYMĚŇUJTE baterie ani neodpojujte síťový adaptér, když jsou naměřené hodnoty přenášeny do chytřeho zařízení. Mohlo by to mít za následek nesprávnou funkci měříče a selhání přenosu dat o krevním tlaku.
- NETAHEJTE za napájecí kabel.
- Při manipulaci s kabelem síťového adaptéra:
 - Zasuňte síťový adaptér zcela do zásuvky.
 - Zabraňte poškození. / Nelámejte jej. / Nepokusujte se jej upravovat. / ZABRAŇTE přískřipnutí. / Násilím jej neohýbejte ani za něj netahejte. / Nekrutejte s ním. / NEPOUŽIVEJTE jej, pokud je smotán ve svazku. / NEPOKLÁDEJTE na něj těžké předměty.
 - Před čištěním přístroje síťový adaptér odpojte.
 - Ze síťového adaptéra odpojte všechn prach.
 - Když síťový adaptér nepoužíváte, odpojte jej od napájení.
 - Před čištěním přístroje síťový adaptér odpojte.

CZ

Síťový adaptér (volitelné příslušenství) – manipulace a použití

- Během měření sledujte paži a zajistěte, aby měříč přesně naměřil hodnoty přenášené do chytřeho zařízení. Mohlo by to mít za následek nesprávnou funkci měříče a selhání přenosu dat o krevním tlaku.
- Před likvidací přístroje a věškerého používaného příslušenství nebo volitelných součástí si přečtěte část „Správná likvidace tohoto produktu“ v kapitole 7 a dodržujte uvedené pokyny.
- NEVYMĚŇUJTE baterie ani neodpojujte síťový adaptér, když jsou naměřené hodnoty přenášeny do chytřeho zařízení. Mohlo by to mít za následek nesprávnou funkci měříče a selhání přenosu dat o krevním tlaku.
- Při manipulaci s kabelem síťového adaptéra:
 - Zasuňte síťový adaptér zcela do zásuvky.
 - Při odpojování síťového adaptéra ze zásuvky.
 - Při manipulaci s kabelem síťového adaptéra:
 - Zabraňte poškození. / Nelámejte jej. / Nepokusujte se jej upravovat. / ZABRAŇTE přískřipnutí. / Násilím jej neohýbejte ani za něj netahejte. / Nekrutejte s ním. / NEPOUŽIVEJTE jej, pokud je smotán ve svazku. / NEPOKLÁDEJTE na něj těžké předměty.
 - Před čištěním přístroje síťový adaptér odpojte.
 - Ze síťového adaptéra odpojte všechn prach.
 - Když síťový adaptér nepoužíváte, odpojte jej od napájení.
 - Před čištěním přístroje síťový adaptér odpojte.

Manipulace s bateriami a jejich použití

- NEVKLÁDEJTE baterie s nesprávně orientovanou polaritou.
- Pro tento měřič používejte POUZE 4 alkalické nebo manganové baterie typu „AA“. NEPOUŽIVEJTE jiné typy baterií. NEPOUŽIVEJTE staré a nové baterie dohromady. NEPOUŽIVEJTE různé známký baterii dohromady.
- Pokud nebudeš měřit delší dobu používaj baterie vyměň.
- Dostane-li se vám kapalina z baterie do očí, ihned je vyplachněte velkým množstvím čisté vody. Okamžitě se poradíte s vaším lékařem.
- Dostane-li se vám kapalina z baterie na polohu, ihned ji opáchchněte velkým množstvím čisté vlažné vody. Pokud podráždění, zranění nebo bolest přetrvává, poradíte se s vaším lékařem.
- NEPOUŽIVEJTE baterie po vypršení jejich doby životnosti.
- Baterie pravidelně kontrolujte, abyste zajistili, že jsou v dobrém provozním stavu.

2.3 Všeobecná bezpečnostní opatření

- Prováděte-li měření na pravé paži, vzduchová hadička musí být na straně od lokte. Dávejte pozor, abyste si paži o ní neopírali.



- Krevní tlak v pravé a levé paži může být různý a naměřená hodnota se může lišit. K měření používejte vždy stejnou paži. Pokud se hodnoty mezi oběma pažemi podstatně liší, poradíte se s lékařem, kterou paží máte k měření používat.
- Při použití volitelného síťového adaptéra nepoužívejte měřič na takových místech, na kterých může být zapojení a odpojení síťového adaptéra obtížné.

Manipulace s bateriami a jejich použití

- Likvidace použitých baterií by měla být provedena v souladu s místními předpisy.
- Dodané baterie mohou mít kratší životnost než nové.

3. Chybová hlášení a řešení problémů

V případě, že se během měření vyskytne některý z níže uvedených problémů, nejprve zkонтrolujte, že se ve vzdálenosti do 30 cm od přístroje nenachází žádné jiné elektrické zařízení. Pokud problém přetravává, nahlédněte do tabulky níže.

Display/problém	Možná příčina	Řešení
E 1 se zobrazuje nebo se manžeta nenaťukuje.	Tlačítko [START/STOP] bylo stisknuto, když manžeta nebyla nasazena na paži. Vzduchová zástrčka není zcela zapojena do měřicí.	Opětovným stisknutím tlačítka [START/STOP] přístroj vypněte. Po bezpečném nasazení vzduchové zástrčky a správném upínání manžety stiskněte tlačítko [START/STOP]. Vložte vzduchovou zástrčku.
E 2 se zobrazuje nebo se nelze měření provést po naťuknutí manžety.	Manžeta není upíněna správně. Z manžety uniká vzduch.	Upevněte manžetu správně a poté proveděte další měření. Přečtěte si kapitolu 7 Návodu k obsluze (2).
E 3 zobrazeno	Během měření se pohybujete nebo mluvíte a manžeta se nenaťukne správně. Pokud je systolický tlak vyšší než 210 mmHg, měření nelze provést.	V průběhu měření zůstaňte v klidu a nemluvte. Pokud se hlášení „E2“ zobrazuje opakovně, naťukněte manžetu ručně tak, aby systolický tlak byl o 30 až 40 mmHg vyšší, než předchozí naměřené hodnoty. Přečtěte si kapitolu 13 Návodu k obsluze (2).
E 4 zobrazeno	Manžeta je naťuknuta na vyšší než maximální povolený tlak.	Během měření se nedotýkejte manžety ani neohýbejte vzduchovou hadičku. Pokud manžetu naťukujete ručně, přečtěte si kapitolu 13 Návodu k obsluze (2).
E 5 zobrazeno	Během měření se pohybujete nebo mluvíte. Vibrace naruší měření.	V průběhu měření zůstaňte v klidu a nemluvte.
	Tepová frekvence není detekována správně.	Upevněte manžetu správně a poté proveděte další měření. Přečtěte si kapitolu 7 Návodu k obsluze (2). V průběhu měření zůstaňte v klidu a správně se usadíte. Pokud se symbol „  “ objevuje i nadále, doporučujeme poradit se s lékařem.
	 zobrazeno	během měření nebliká

CZ

CZ4

Displej/problém	Možná příčina	Řešení
E5 zobrazeno	Měření krevního tlaku nebylo provedeno v režimu Afib správně.	Upevněte manžetu správně a poté provedte další měření. Přečtěte si kapitolu 7 Návodu k obsluze (2) . V průběhu měření zůstaňte v klidu a správně se usaděte. Přečtěte si kapitolu 8 Návodu k obsluze (2) .
E7 zobrazeno	Měřič má závadu.	Stískněte znovu tlačítka [START/STOP]. Pokud se stále objevuje symbol „Er“, obrátte se na maloobchodního prodejce nebo distributora společnosti OMRON.
E11 zobrazeno	Měřič se nemůže připojit k chytrému zařízení nebo správně přenést data.	Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci „OMRON connect“. Pokud se po kontrole aplikace stále objevuje symbol „Err“, obrátte se na maloobchodního prodejce nebo distributora OMRON.
P bliká	Měřič čeká na spárování s chytrým zařízením.	Přečtěte si kapitolu 5 Návodu k obsluze (2) s pokyny ke spárování měřiče s chytrým zařízením nebo stisknutím tlačítka [START/STOP] zrušte párování a měřič vypněte.
P bliká	Měřič je připraven k přenosu naměřených hodnot do chytrého zařízení.	Otevřete aplikaci „OMRON connect“ a spusťte přenos naměřených hodnot.
N bliká	Není přeneseno více než 80 měření.	Chcete-li naměřené hodnoty uložit v paměti aplikace „OMRON connect“, správujte měřič nebo přeneste naměřené hodnoty. Symbol chyby poté zmizí.
Z zobrazeno	Datum a čas nejsou nastaveny.	Doporučujeme vyměnit všechny 4 baterie za nové. Přečtěte si kapitolu 4 Návodu k obsluze (2) .
Z zobrazeno	Není přeneseno 100 měření.	Okamžitě vyměňte všechny 4 baterie za nové. Přečtěte si kapitolu 4 Návodu k obsluze (2) .
■ zobrazeno, nebo se měřic během měření neočekávaně vypne	Baterie jsou vybité.	CELIMED
■ zobrazeno	Baterie jsou vybité.	Nesprávná polarita baterií.
■ zobrazeno	Baterie jsou vybité.	Zkontrolujte správné umístění baterií. Přečtěte si kapitolu 4 Návodu k obsluze (2) .
■ zobrazeno	Naměřené hodnoty se zdají příliš vysoké či příliš nízké.	Krevní tlak neustále kolísá. Váš krevní tlak může ovlivnit mnoho faktorů včetně stresu, denní doby a/nebo způsobu aplikace manžety. Přečtěte si kapitolu 2 Návodu k obsluze (2) .

Display/problém	Možná příčina	Řešení
Nastane jakýkoli jiný komunikační problém.	Postupujte podle pokynů zobrazených na chytrém zařízení nebo vyhledejte další nápovedu v nabídce „Help“ (Nápověda) aplikace „OMRON connect“. Pokud problém přetrvává, kontaktujte maloobchodního prodejce nebo distributora společnosti OMRON.	
Nastane jiný problém.	Vypněte měřicí stisknutím tlačítka [START/STOP]; poté tlačítko stiskněte znovu a provedte měření. Pokud problém přetrvává, vyměňte baterie a vyčkejte 30 sekund. Poté baterie znovu nainstalujte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte maloobchodního prodejce nebo distributora společnosti OMRON.	
Řešení problémů funkce indikátoru Afib:		
Jaký je rozdíl mezi funkcí indikátoru Afib a EKG?	Funkce Afib a EKG využívají zcela odlišné technologie. EKG měří elektrickou aktivitu srdečního srdce a umožňuje diagnostiku fibrilace síní. Funkce indikátoru Afib zjišťuje nepravidelný srdeční rytmus a upozorňuje na možnou fibrilaci síní s citlivostí 95,5 % a specificitou 93,8 %. Podrobnosti naleznete v kapitole 11.	
Pokud se symbol „⌚“ nezobrazuje, znamená to, že nemůže docházet k fibrilaci síní?	K fibrilaci síní může docházet, i když se symbol „⌚“ nezobrazuje.	
Mám se obrátit na lékaře, pokud se zobrazi symbol „⌚“?	Doporučujeme, abyste se poradili s lékařem, protože existuje možnost fibrilace síní. Symbol „⌚“ se však může zobrazovat i z jiných důvodů, např. jiné srdeční arytmie.	
Jaký je rozdíl mezi funkcí indikátoru Afib a funkcí detekce nepravidelné srdeční činnosti?	Funkce detekce nepravidelné srdeční činnosti zjišťuje nepravidelný srdeční rytmus v rámci jednoho měření. Funkce indikátoru Afib upozorňuje na možnost fibrilace síní, když je krevní tlak měřen 3krát po sobě.	
Co mám dělat, pokud se občas zobrazi symbol „⌚“?	Fibrilace síní není vždy provázena příznaky. Doporučujeme poradit se s lékařem a dodržovat jeho pokyny.	
Lékař mi diagnostikoval fibrilaci síní, ale symbol „⌚“ se nezobrazuje.	K fibrilaci síní nemusí docházet v době příslušného měření krevního tlaku. Doporučujeme, abyste se pravidelně obraceli na svého lékaře.	
Je naměřená hodnota krevního tlaku spolehlivá, pokud se zobrazuje symbol „⌚“?	Fibrilace síní nebo nepravidelný srdeční rytmus mohou měření krevního tlaku ovlivnit a naměřené hodnoty nemusí být přesné. Rozdíly můžete kompenzovat provedením opakování měření.* V režimu Afib je měření krevního tlaku prováděno 3krát a poté se zobraží průměrné hodnoty. Měřic zobrazí chybové hlášení (E5/E6), pokud je vliv nepravidelného srdečního rytmu na výsledek měření příliš významný. Pokud k této situaci dochází opakováně, doporučujeme poradit se s lékařem.	

4. Omezená záruka

Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti OMRON. Tento výrobek je sestaven z vysoce kvalitních materiálů a při jeho výrobě bylo dbáno velké pečlivosti. Je navržen tak, aby vás uspokojil ve všech směrech za předpokladu, že bude správně používán a udržován dle pokynů v návodu k obsluze.

Společnost OMRON na tento výrobek poskytuje záruku v délce 3 roky od data zakoupení. Společnost OMRON ručí za správnou konstrukci, zpracování a materiály tohoto záručního období společnost OMRON bez poplatku za práci nebo díly opraví nebo vymění vadný výrobek nebo jeho vadné části.

Záruka se nevztahuje na následující situace:

- A. Náklady na dopravu a rizika při dopravě.
- B. Náklady na opravy a/nebo vadu vzniklé opravami neoprávněnými osobami.
- C. Pravidelné kontroly a údržbu.
- D. Selhání nebo opotřebení volitelného příslušenství nebo jiných doplňků jiných než samotné hlavní jednotky, nejsou-li výslovně uvedeny výše.
- E. Náklady vzniklé vlivem nepřijetí reklamace (tyto budou účtovány).
- F. Škody jakéhokoli druhu, včetně osobních, způsobených náhodně nebo chyboum používání.
- G. Služby kalibrace nejsou součástí záruky.
- H. Na volitelné příslušenství se vzťahuje záruka jeden (1) rok od data zakoupení.

Volitelné díly zahrnují mimo jiné následující položky: manžetu a hadičku manžety.

Pokud je nutné využít služeb záručních oprav, požádejte o opravu prodejce, od kterého ještě produkt zakoupili, nebo autorizovaného distributora společnosti OMRON. Adresu naleznete na obalu produktu / v dokumentaci nebo u specializovaného prodejce.

Máte-li potíže s výhledováním servis znácky OMRON, společnost CELIMED s.r.o., kontaktujte násautorizovaný servis znácky OMRON, společnost CELIMED s.r.o., Opravy nebo vyměny v rámci záruky neposkytuji právo na prodloužení nebo obnovení záruční doby.

Záruka bude poskytnuta, pouze pokud je vrácen úplný produkt společně s originální fakturovou/účtenkovou vydanou zákazníkovi prodejem.

5. Údržba

5.1 Údržba

Abyste uchránili svůj měřicí přístroj poškozením, dodržujte následující pokyny:
Změny nebo úpravy neschválené výrobcem způsobí propadnutí záruky uživateli.

⚠ Upozornění

Měřič nebo jeho součásti NEROZBÍREJTE ani se je NEPOKOUŠEJTE OPRAVOVAT. Mohlo by to vést k nepřesnému měření.

5.2 Skladování

- Pokud měřič nepoužíváte, ulohovávejte její v úložném pouzdře.

- 1. Odpojte manžetu od měřiče.

⚠ Upozornění

Chcete-li odpojít vzduchovou zástrčku, zatáhněte za plastovou vzduchovou zástrčku v základě hadičky, nikoli za hadičku samotnou.

- 2. Opatrně vzduchovou hadičku zabalte do manžety. Poznámka: Vzduchovou hadičku nadměrně neožíbejte ani nemáčejte.

- 3. Uložte přístroj a ostatní součásti do úložného pouzdra.

- Přístroj a ostatní součásti uložte na bezpečném a čistém místě.

- Pokud jsou přístroj a ostatní součásti neukládejte v následujícím případě:

- • Na místech vyštavených extrémním lepotám, vlnění, výfukostí, přímenu slunečnímu světlu, prachu nebo korozivním výparům, například bělidlům.
- Na místech vyštavených vibracím nebo otřesům.
- Na ochranu přístroje během skladování je jako příslušenství k dispozici volitelný kryt LCD displeje. Přečtěte si kapitolu 15 Návodu k obsluze **2**.

5.3 Čištění

- Nepoužívejte abrazivní nebo těkavé čisticí prostředky.

- K čištění měřiče a manžety použijte suchý měkký kus látky zvlhčený neutrálním čisticím prostředkem a poté je utřete suchým kusem látky.

- Měřič, manžetu ani další součásti neomývejte vodou ani neponořujte do vody.

- K čištění měřiče, manžety a ostatních součástí nepoužívejte benzín, ředitla ani jiné těkavé kapaliny.

5.4 Kalibrace a servis

- Přesnost tohoto měřiče krevního tlaku byla pečlivě testována a je navržena pro dlouhodobou životnost.

- Obecně se doporučuje nechat přístroj zkонтrolovat po dvou letech, aby se ověřilo jeho správné fungování a přesnost. Obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaný servis znácky OMRON, společnost CELIMED s.r.o., na adresu: www.celimed.cz

6. Technické údaje

Kategorie výrobku	Elektronický tlakoměr
Popis výrobku	Automatický měřič krevního tlaku na paži
Model (kód)	M7 Intelli IT (HEM-7361T-EBK)
Displej	Digitální LCD displej
Rozsah tlaku manžety	0 až 299 mmHg
Rozsah měření krevního tlaku	SYS: 60 až 260 mmHg DIA: 40 až 215 mmHg
Rozsah měření pulsu	40 až 180 tepů/min.
Přesnost	Tlak: ±3 mmHg Puls: ±5 % zobrazené hodnoty
Nafukování	Automatický elektrickou pumpou
Vypouštění	Automatický tlakový vypouštěcí ventil
Metoda měření	Oscilometrická metoda
Přenosová metoda	Bluetooth® Low Energy
Bezdrátová komunikace	Frekvenční rozsah: 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) / Modulace: GFSK Efektivní intenzita záření: < 20 dBm
Režim provozu	Nepřetížitý provoz
Stupeň krytí IP	Hlavní jednotka: IP20 Volitelný sítový adaptér: IP21 (HHP-CM01) nebo IP22 (HHP-BFH01)
Příkon	6 V DC, 4,0 W
Zdroj energie	4 baterie „AA“ 1,5 V nebo volitelný sítový adaptér (VSTUP 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,12–0,065 A)

Životnost baterie	Přibližně 1000 měření (pomocí nových alkalicích baterií) Počet měření se může snížit, pokud používáte režim Afib, protože jedna indikace Afib se skládá ze 3 běžných měření.
Doba životnosti (provozní životnost)	Měří: 5 let / Manžeta: 5 let / Volitelný sítový adaptér: 5 let
Provozní podmínky	+10 až +40 °C / 15 až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) / 800 až 1060 hPa
Podmínky pro skladování/přepravu	-20 až +60 °C / 10 až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Hmotnost	Měří: přibližně 460 g (bez baterii) Manžeta: přibližně 163 g
Rozměry (přibližné)	Měří: 191 mm (š) x 85 mm (v) x 120 mm (d) / Manžeta: 145 mm x 532 mm (vzdichová hadička: 750 mm)
Obvod manžety použitelný pro měření	220 až 420 mm
Paměť	Ukládá až 100 naměřených hodnot na uživateli
Obsah	Měří, manžeta (HEM-FL31), 4 baterie „AA“, Návody k obsluze ① a ②, pokyny k nastavení, úložné pouzdro
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	Vnitřně napojené vybavení typu ME (isou-li používány pouze baterie) Vybavení ME třídy II (volitelný sítový adaptér)
Přiložná část	Typ BF (manžeta)
Maximální teplota přiložené části	Nižší než +43 °C

CZ

CZ8

CELLMED

Poznámka

- Tyto technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento měřič byl klinicky přezkoumán podle požadavků normy ISO 81060-2:2013. V klinické validaci studii bylo do K5 zapojeno 85 subjektů pro stanovení diastolického krevního tlaku.
- Toto zařízení bylo schváleno k použití u těhotných a preeklamptických pacientek podle upraveného protokolu Evropské společnosti pro hypertenzi (European Society of Hypertension) *.
- Toto zařízení bylo schváleno k použití u diabetických (typ II) pacientů **.
- IP klasifikace uvádí stupně ochrany zajišťované krytem v souladu s normou IEC 60529. Tento přístroj a volitelný síťový adaptér jsou chráněny před vniknutím cizích pevných objektů o průměru 12,5 mm a větších, například prstu. Volitelný síťový adaptér HHP-CM01 je chráněn před kolmo dopadajícími kapkami vody, které mohou způsobovat potíže během normálního provozu. Volitelný síťový adaptér HHP-BF01 je chráněn před šíkmo dopadajícími kapkami vody, které mohou způsobovat potíže během normálního provozu.

* Topouchian J et al. Vascular Health and Risk Management 2018;14:189–197

** Chahine M.N. et al. Medical Devices: Evidence and Research 2018;11:11–20

Orušení bezdrátové komunikace


Tento výrobek funguje v nelicencovaném pásmu ISM při 2,4 GHz. V případě, že je výrobek používán v blízkosti dalších bezdrátových zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN, které využívají stejně frekvenci pásmo jako tento výrobek, může docházet k rušení. Pokud k rušení dojde, zastavte provoz dalších zařízení nebo tento výrobek přesuňte dál od ostatních bezdrátových zařízení předmět, než se jej pokusíte znova použít.

7. Správná likvidace tohoto produktu (odpadní elektrické a elektronické vybavení)

Toto označení na produktu nebo v příslušném návodu značí, že se produkt na konci své technické životnosti nesmí likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Abyste zabránili případným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tento produkt od ostatních typů odpadu a zodpovědně jej recykujte – příspějete tak k trvalému opětovnému použití zdrojů materiálu.

Podrobnosti o tom, kde a jak se dá toto zařízení bezpečně recyklovat s ohledem na životní prostředí, mohou domácí uživatelé získat bud' u prodejce, u kterého si tento produkt pořídili, nebo mohou kontaktovat místní obecní úřad.

Komerční uživatelé nech' kontaktují svého dodavatele a prověří okolnosti a podmínky uvedené v kupní smlouvě. Tento produkt se nesmí zařadit mezi ostatní technický odpad určený k likvidaci.



8. Důležité informace týkající se elektromagnetické kompatibiliti (EMC)

Výrobek HEM-7361T-EBK/ESL je v souladu s požadavky normy EN 60601-1-2:2015 pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Další dokumentace v souladu s normou EMC je k dispozici ve společnosti OMRON HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedené v tomto návodu k obsluze nebo na stránkách www.omron-healthcare.com.

9. Doporučení a prohlášení výrobce

- Tento měřič krevního tlaku byl navržen v souladu s Evropským standardem EN1060, mechanické neinvazivní krevní tlakoměry, část 1: Všeobecné požadavky a část 3: Doplňkové požadavky pro elektromechanické systémy pro měření krevního tlaku.
- Společnost OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu HEM-7361T-EBK/ESL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adresě: www.omron-healthcare.com
- Tento výrobek společnosti OMRON je vyroben v souladu s přísným systémem pro kontroly kvality společnosti OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonsko. Tlakový senzor - hlavní součást měřiče krevního tlaku společnosti OMRON je vyroben v Japonsku.
- Veškeré závažné incidenty, ke kterým došlo v souvislosti s tímto zařízením, oznamte výrobci a příslušnému úřadu v členském státě, ve kterém sídlíte.

10. Jak vypočítat týdenní průměry


výpočet ranního týdenního průměru

Toto je průměr z měření provedených ráno (4:00–9:59) od neděle do soboty. Pro výpočet ranního průměru každého dne budou použita 2 nebo 3 měření provedené během prvních 10 minut ráno mezi 4:00–9:59.

výpočet večerního týdenního průměru

Toto je průměr z měření provedených večer (19:00–1:59) od neděle do soboty. Pro výpočet večerního průměru každého dne budou použita 2 nebo 3 měření provedené během posledních 10 minut večer mezi 19:00–1:59.

CELIMED

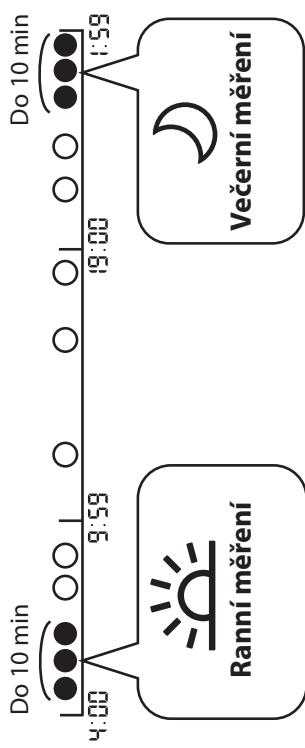

11. Užitečné informace

Co je krevní tlak?

Krevní tlak je velikost síly, kterou působí krev na stěnu tepen. Arteriální krevní tlak se během srdcniho cyklu stále mění. Nejvyšší tlak během cyklu se nazývá systolický krevní tlak; nejnižší pak diastolický krevní tlak. Obě hodnoty tlaku, systolická i diastolická jsou nezbytné k tomu, aby mohli lékař posoudit stav pacientova krevního tlaku.

Co je arytmie?

Při arytmii je srdeční akce abnormální v důsledku poruchy bioelektrického systému, který řídí srdeční akci. Typickými příznaky jsou pocit vynechávajícího srdce, předčasné stahy, abnormálně rychlý puls (tachykardie) nebo abnormálně pomalý puls (bradykardie).

Co je Afib?

Fibrilace síní (označovaná jako Afib nebo AF) je chvění nebo nepravidelná srdeční činnost (arytmie), která může vést ke krevním sráženinám, mozkové příhodě, srdečnímu selhání a dalším kardiologickým komplikacím. Během fibrilace síní dvě horní dutiny srdce (slně) pracují chaoticky a nepravidelně – jejich činnost není koordinována se spodními dutinami (komorami). Epizody fibrilace síní mohou přicházet a odcházet, může však také dojít k fibrilaci síní, která nepomine a vyžaduje ošetření.

Funkce indikátoru Afib zjišťuje možnost fibrilace síní s přesností 94,2 % (s citlivostí 95,5 % a specifitou 93,8 %), což bylo prokázáno pomocí studie* s jednosvodovým EKG jakožto referenčním měřením.

* M. Ishizawa, T. Noma, T. Minamino et al., Multiple measurements with automated blood pressure monitor can detect atrial fibrillation with high sensitivity and specificity in general cardiac patients, ESC Congress 2018

Popis symbolů

	Příložná část - typ BF. Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem (svodový proud)
	Zařízení třídy II. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
IP XX	Stupeň ochrany proti vniknutí zajišťovaný normou IEC 60529
	Označení CE
	Sériové číslo
	Číslo šarže
	Zdravotnický prostředek
	Označení katalogového čísla výrobce
	Omezení teploty
	Omezení vlhkosti
	Omezení atmosférického tlaku
	Označení polarity konektoru

	Pouze pro použití uvnitř budov
	Technologie společnosti OMRON s ochranou známkou pro měření krevního tlaku
	Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením
	Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.
	Značka kontroly kvality výrobce
LATEX FREE	Není vyrobeno z latexu
	Obvod paže
	Uživatel si musí prostudovat tento návod k obsluze.
	Uživatel musí pečlivě dodržovat pokyny v tomto návodu k obsluze kvůli zajištění bezpečnosti.
	Stejnosměrný proud
	Střídavý proud
	Datum výroby
	Zakázaný postup
	CELI MED



K indikaci obecně zvýšených, potenciálně nebezpečných úrovní neionizujícího záření, nebo k indikaci zařízení či systému, např. v oblasti zdravotnických elektrických zařízení, která obsahuje radiofrekvenční vysílače nebo která zároveň používá radiofrekvenční elektromagnetickou energii k diagnóze nebo léčbě.

Logotyp a logo **Bluetooth**® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. podléhá licenci. Ostatní obchodní znacky a obchodní názvy jsou majetkem svých vlastníků. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

CZ

CELI MED

Poznámky:



Výrobce 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zástupce pro EU 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Výrobní závod	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Pobočky	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, NĚMECKO www.omron-healthcare.com
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCIE www.omron-healthcare.com
Distribuce a servis pro ČR a metrologické ověření pro lékařské zřízení	CELIMED s.r.o. Sociální péče 3487/5a, 40011 Ústí nad Labem pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz  www.celimed.cz

Datum vydání: 2019-10-15

IM1-HEM-7361T-E-CZ-03-10/2019

Návod k obsluze Instruction Manual


2

Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor

M7 Intelli IT s AFib



All for Healthcare

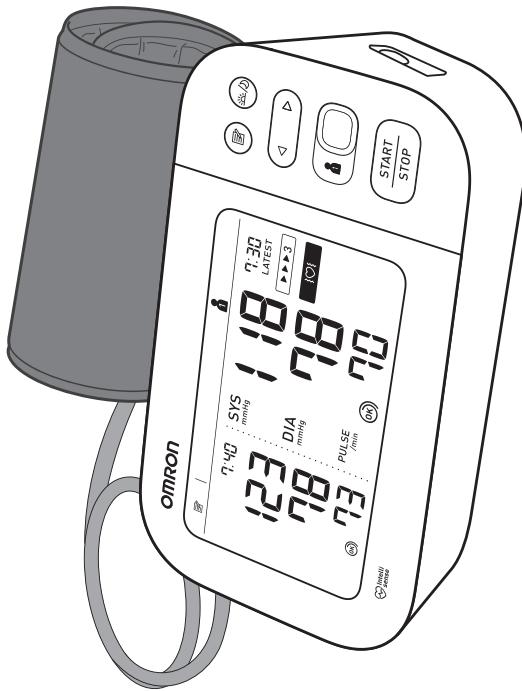

Read Instruction manual ① and ② before use.

PL Przed rozpoczęciem korzystania z ciśnieniomierza należy przeczytać instrukcję obsługi ① i ②.

CZ Před použitím si přečtěte Návody k obsluze ① a ②.

HU Használattal előtt olassa el a(z) ① és ② használati útmutatókat.

SK Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu ① a ②.

SL Pred uporabo preberite priročnik z navodili ① in ②.

HR Pročitajte priručnik s uputama ① i ② prije upotrebe.

1	Package Contents	3
PL	Zawartość opakowania	SK Obsah balenia
CZ	Obsah balení	SL Vsebina embalaže
HU	A csomag tartalma	HR Sadržaj pakiranja
2	Preparing for a Measurement	4
PL	Przygotowanie do pomiaru	SK Priprava na meranie
CZ	Příprava na měření	SL Priprava na meritev
HU	A mérés előkészítése	HR Pripremanje za mjerjenje
3	Downloading the "OMRON connect" App	5
PL	Pobieranie aplikacji „OMRON connect”	SK Stiahnutie aplikácie „OMRON connect”
CZ	Stážení aplikace „OMRON connect”	SL Prenos aplikácie „OMRON connect”
HU	Az „OMRON connect” alkalmazás letöltése	HR Preuzimanje aplikacije „OMRON connect”
4	Inserting Batteries	6
PL	Instalacja baterii	SK Vloženie batérii
CZ	Vložení baterii	SL Vstavjanje baterij
HU	Az elemek behelyezése	HR Umetanje baterija
5	Pairing Your Smart Device	7
PL	Parowanie ciśnieniomierza z urządzeniem intelligentnym zariadením	SK Párovanie s inteligentným zařízením
CZ	Spárování s chytrým zařízením	SL Seznamjanje s pametno napravo
HU	Okoseszkközzel történő párosítás	HR Uparivanje pametnog uređaja
6	Setting Date and Time Manually	8
PL	Ręczne ustawianie daty i godziny	SK Manuálne nastavenie dátumu a času
CZ	Ruční nastavení data a času	SL Ročna nastavitev datuma in ure
HU	A dátum és az idő kézi beállítása	HR Ručno postavljajte datumu i satu
7	Applying the Cuff on the Left Arm	9
PL	Zakładanie mankietu na lewe ramię	SK Nasadenie manžety na ľavé rameno
CZ	Umístění manžety na levou paži	SL Namestitev manžete na levo roko
HU	A mandzsetta bal karra történő felhelyezése	HR Stavljanje manžete na lijevu ruku
8	Sitting Correctly	11
PL	Prawidłowa pozycja ciała	SK Správne sedenie
CZ	Správné sezení	SL Pravilna postavitev
HU	A megfelelő ülőhelyzet	HR Pravilno sjedenje
9	Selecting User ID (1 or 2)	13
PL	Wybór identyfikatora użytkownika (1 lub 2)	SK Výber ID používateľa (1 alebo 2)
CZ	Výber ID uživatele (1 nebo 2)	SL Izbiranje ID-ja uporabnika (1 ali 2)
HU	A felhasználói azonosító kiválasztása (1 vagy 2)	HR Odabir korisničke identifikacijske oznake (1 ili 2)
10	Taking a Measurement	14
PL	Wykonywanie pomiaru	SK Meranie tlaku krvi
CZ	Měření	SL Odčítavanie merítve
HU	Mérés	HR Mjerenje

11	Checking Readings in Comparison Mode	18
PL	Sprawdzanie odczytów w trybie porównawczym	SK Kontrola nameraných hodnôt v režime porovnávania
CZ	Kontrola naměřených hodnot ve srovnávacím režimu	SL Primerjalni pregled odčitkov
HU	redmények ellenőrzése összehasonlító módban	HR Provjera ocitanja u načinu usporedbe
12	Using Memory Functions	23
PL	Korzystanie z funkcji pamięci	SK Používanie funkcie pamäte
CZ	Použití funkcí paměti	SL Uporaba funkcij pomnilnika
HU	A memória funkciók használata	HR Upotreba memorijске funkcije
13	Other Settings	26
PL	Inne ustawienia	SK Ďalšie nastavenia
CZ	Další nastavení	SL Druge nastaviteve
HU	Egyéb beállítások	HR Ostale postavke
14	Optional Medical Accessories	29
PL	Opcjonalne akcesoria medyczne	SK Voliteľné zdravotnícke príslušenstvo
CZ	Voliteľné zdravotnické príslušenství	SL Izbirni medicinski pripomočki
HU	Opcionális orvos alkatrészek	HR Opcijska dodatna medicinska oprema
15	Other Optional Parts	30
PL	Inne części opcjonalne	SK Ďalšie voliteľné súčasti
CZ	Další voliteľné díly	SL Drugi izbirni deli
HU	További opcionális alkatrészek	HR Drugi neobavezni dijelovi

1 Package Contents

PL Zawartość opakowania


CZ Obsah balení

HU A csomag tartalma

SK Obsah balenia

SL Vsebina embalaže

HR Sadržaj pakiranja

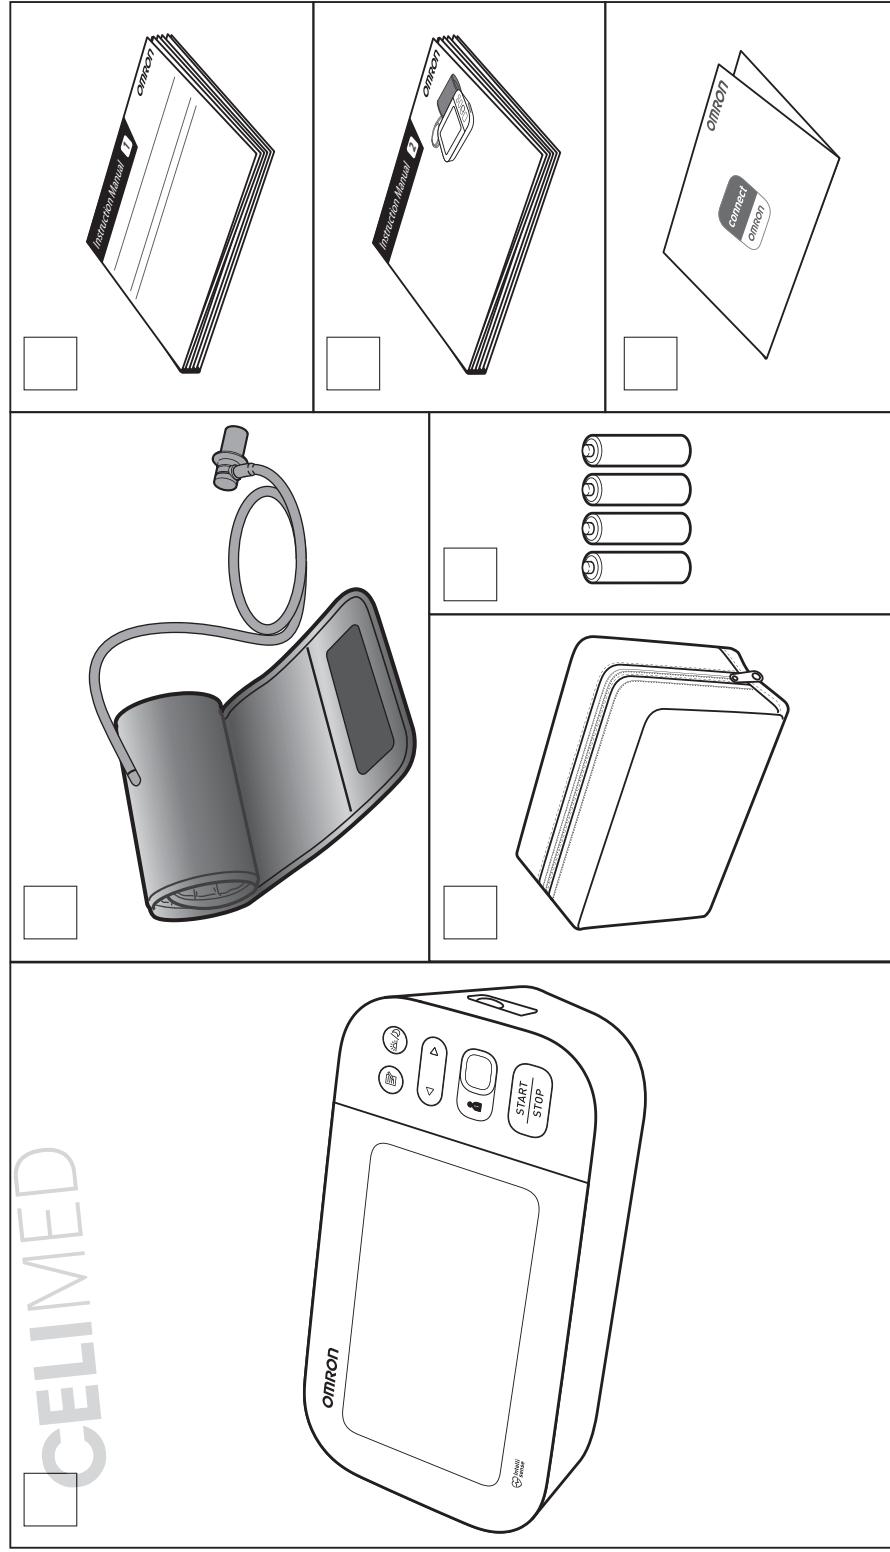

CELI MED

2 Preparing for a Measurement

PL Przygotowanie do pomiaru

CZ Příprava na měření

HU A mérés előkészítése

SK Priprava na meranie

SL Priprava na meritev

HR Pripremanje za mjerenje

30 minutes before

PL 30 minut przed

CZ 30 minut před měřením

HU 30 perccel előtte

SK 30 minút vopred

SL 30 minut prej

HR 30 minuta prije



5 minutes before: Relax and rest.

PL 5 minut przed: odpocznij.


CZ 5 minut před měřením: Uvolněte se a odpočívejte.

HU 5 perccel előtte: Nyugodjon meg és pihenjen.

SK 5 minút vopred: Uvoľnite sa a oddychujte.

SL 5 minut prej: sprostite se in počivajte.

HR Pet minuta prije: opustite se i odmorite.

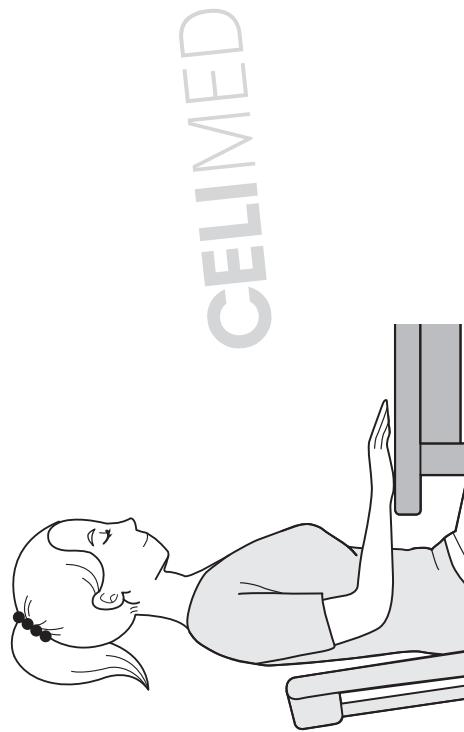

3 Downloading the "OMRON connect" App

PL


CZ Stažení aplikace „OMRON connect“

HU Az „OMRON connect“ alkalmazás letöltése

SK Stiahnutie aplikácie „OMRON connect“

SL Prenos aplikacije „OMRON connect“

HR Preuzimanje aplikacije „OMRON connect“

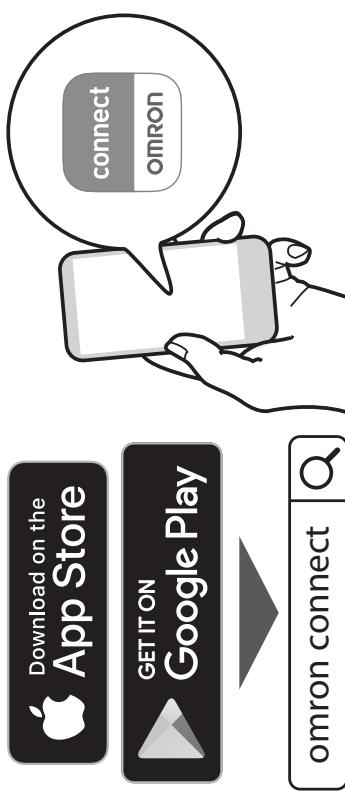

Další informace naleznete na: www.celimed-connect.cz

4 Inserting Batteries


PL Instalacja baterii

CZ Vložení baterií


HU Az elemek behelyezése

CELLMED


SK Vloženie batérií
SL Vstavjanje baterij
HR Umetanje baterija

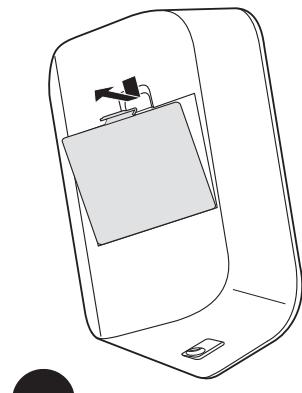

2

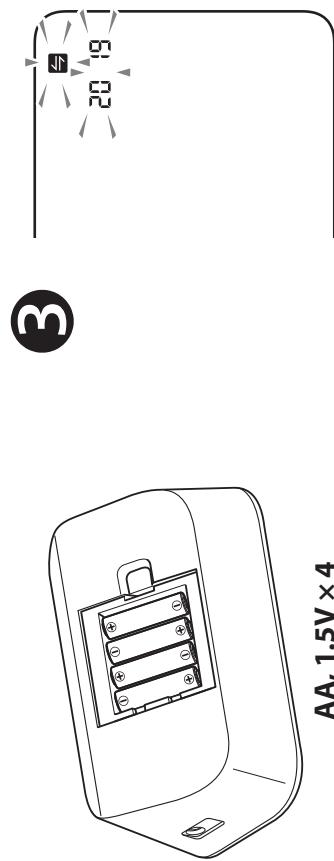

3

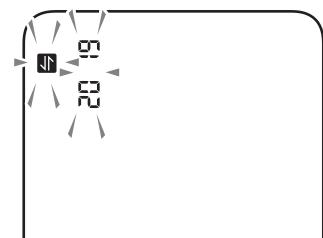


CELLMED

5 Pairing Your Smart Device

- PL** Parowanie ciśnieniomierza z urządzeniem intelligentnym
CZ Spárování s chytrým zařízením
HU Okoseszközzel történő párosítás

- SK** Párovanie s inteligentným zariadením
SL Seznanjanje s pametno napravo
HR Uparivanje pametnog uređaja

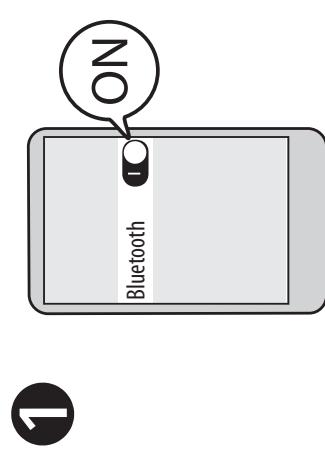

3

Follow the instructions.

- PL** Przestrzegać wszystkich instrukcji.
CZ Postupujte podle pokynů.
HU Kövesse az utasításokat.
SK Riadťte sa pokynmi.
SL Upoštevajte navodila.
HR Pridržavajte se uputa.

The date and time will automatically be set when your monitor is paired with the app.

PL Po sparowaniu ciśnieniomierza z aplikacją nastąpi automatyczne ustawienie daty i godziny.

CZ Po spárování měřiče s aplikací dojde k automatickému nastavení data a času.

HU A dátumot és az időt automatikusan beállítja, amint a vérnyomásmérőt párosítja az alkalmazással.

SK Dátum a čas sa nastavia automaticky, keď sa merač spáruje s aplikáciou.

SL Datum in ura se bosta samodejno posodobila, ko merilnik seznanite z aplikacijo.

HR Datum i sat automatski se postavljaju kada uparite tlakomjer s aplikacijom.

CELI MED

6 Setting Date and Time Manually

PL Ręczne ustawianie daty i godziny

CZ Ruční nastavení data a času

HU A dátum és az idő kézi beállítása

If your monitor is paired with your smart device, date and time is set automatically. When you need to set them manually, set year > month > day > hour > minute.

PL Jeżeli ciśnieniomierz jest sparowany z urządzeniem intelligentnym, ustawienie daty i godziny odbywa się automatycznie. Jeżeli zachodzi potrzeba ustawienia ręcznego, ustawić rok > miesiąc > dzień > godzinę > minutę.

CZ Pokud je měřič spárován s chytrým zařízením, datum a čas budou nastaveny automaticky. Pokud potřebujete nastavit datum a čas ručně, nastavte je v pořadí rok > měsíc > den > hodina > minuta.

SK Manuálne nastavenie dátumu a času

SL Ročna nastavitev datuma in ure


HR Ručno postavljanje datuma i sata

HU Ha Ön párosítja vényomásmóréjét és okoseszközét, akkor a dátum és az idő automatikusan beállításra kerül. Ha az értékeket kézzel kell beállítania, akkor ezt az év > hónap > nap > óra > perc sorrendben teheti meg.

SK Akже ваш мерач спарований з інтелектуальним засідом, датум а час са наставия автоматicky. Ак іх потрібуєте настивити ручане, наставте рок > месяц > ден > годину > хвінту.

SL Če je merilnik seznanjen s pametno napravo, sta datum in ura samodejno nastavljena. Če ju morate nastaviti ročno, nastavite leto > mesec > dan > uro > minute.

HR Ako vam je tlakomjer uparen s pametnim uređajem, datum i sat postavljaju se automatski. Kada ih trebate ostaviti ručno, postavite > mjesec > dan > sat > minuta.

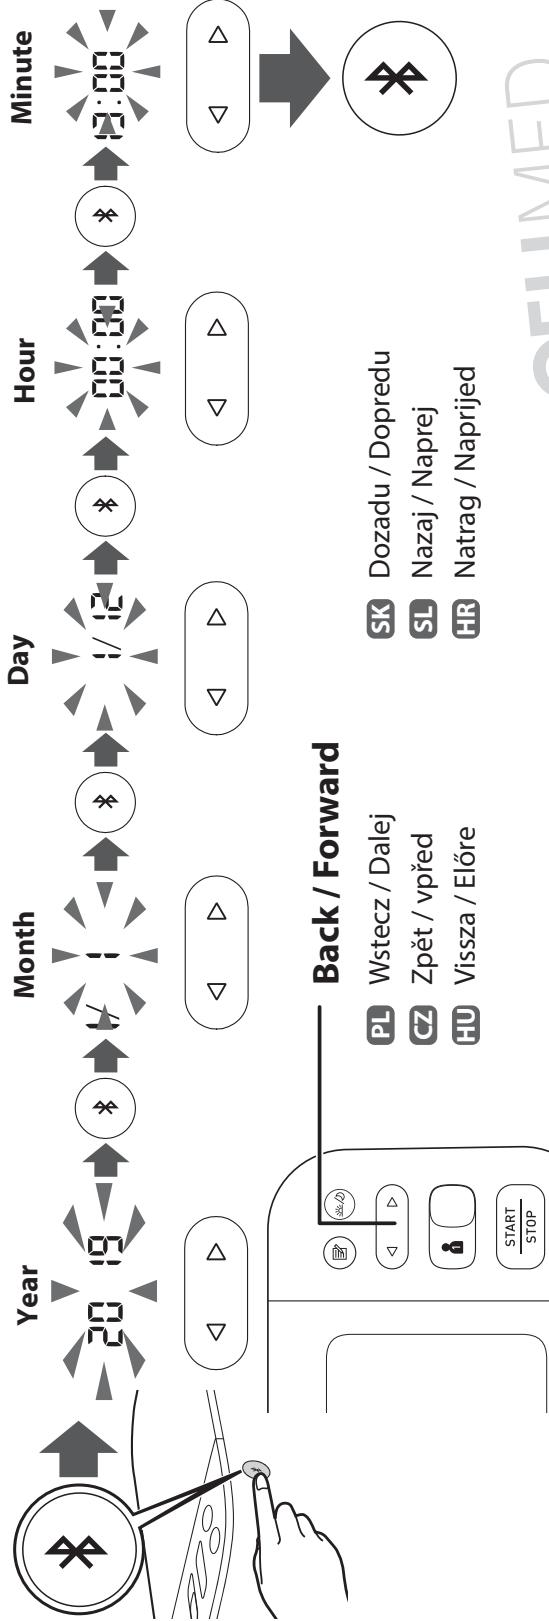

CELI MED

7 Applying the Cuff on the Left Arm

PL Zakładanie mankietu na lewe ramię

CZ Umístění manžety na levou paži

HU A manzsetta bal karra történő felhelyezése


SK Nasadenie manžety na ľavé rameno

SL Namestitev manšete na levo roko

HR Stavljanje manžete na lijevu ruku

1

CELI MED


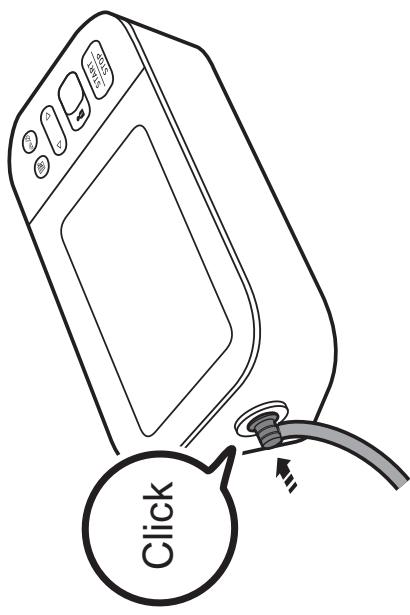


2



3

4

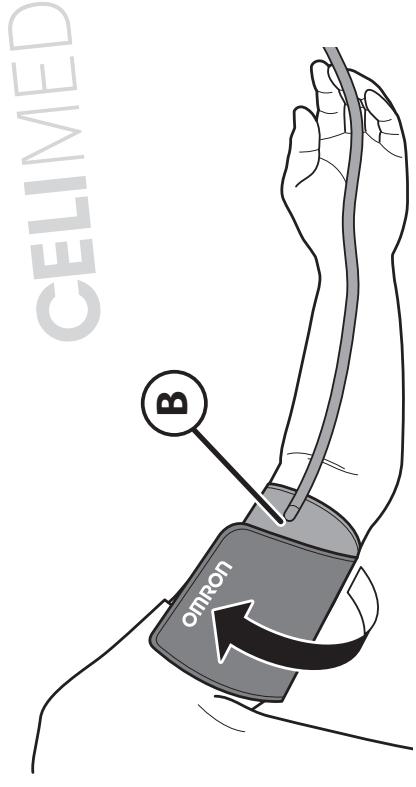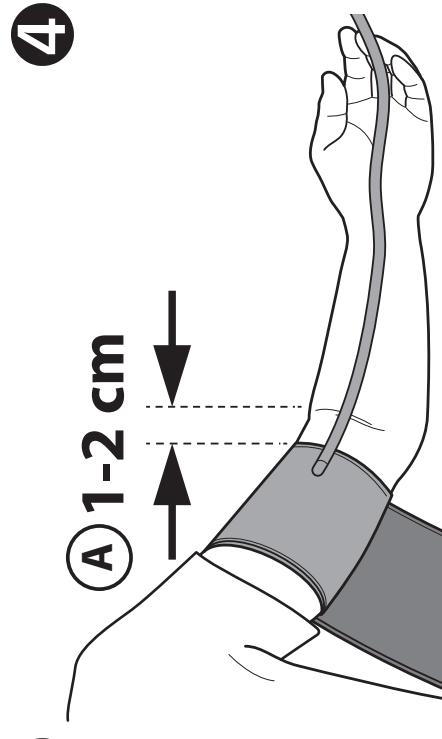

A **Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.**

PL Koniec mankietu wyposażony w przewód powietrza powinien znajdować się 1–2 cm powyżej zgięcia łokcia.
CZ Manžeta by měla být umístěna stranou s hadičkou 1 až 2 cm nad vnitřní stranou lokte.

HU A mandzsetta levegőcső felőli része körülbelül 1-2 cm-re legyen a könyök belső része fölött.

SK Strana manžety s hadičkou má byť 1 až 2 cm nad vnútornou stranou laktá.

SL Stran manšete s cevjo naj bo 1 do 2 cm nad notranjo stranjo komolca.

HR Strana cijevi manžete mora biti 1 do 2 cm iznad unutrašnjosti lakta.

B **Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff securely so it can no longer slip round.**

PL Upewnić się, że przewód powietrza znajduje się po wewnętrznej stronie ramienia i owiniąć starannie mankiet, aby się nie zsuwał.

CZ Dbejte na to, aby vzduchová hadička byla na vnitřní straně paže, a manžetu bezpečně oviněte tak, aby se nemohla otáčet kolem ruky.

HU Ellenőrizze, hogy a levegőcső a kar belső részénél legyen, és a mandzsettát úgy rögzítse, hogy az ne csuszkáljon, hanem stabilan a karján maradjon.

SK Uistite sa, že je vzduchová hadička na vnútornej strane ramena a bezpečne obmotajte manžetu, aby sa nemohla posúvať.

If taking measurements on the right arm, refer to:

PL Pomiar ciśnienia na prawym ramieniu, patrz:



CZ Pokud provádíte měření na pravé paži, přečtěte si:

HU Ajobb karon történő vényomásnével kapcsolatos információkért lásd:

SK Pri meraní na pravom ramene si pozrite:

SL Če meritev izvajate na desni roki, glejte:

HR Ako obavljate mjerenja na desnoj ruci, pogledajte sljedeće:

8 Sitting Correctly


PL Prawidłowa pozycja ciała

CZ Správné sezení

HU A megfelelő ülőhelyzet

SK Správne sedenie
SL Pravilna postavitev
HR Pravilno sjedenje

CELIMED

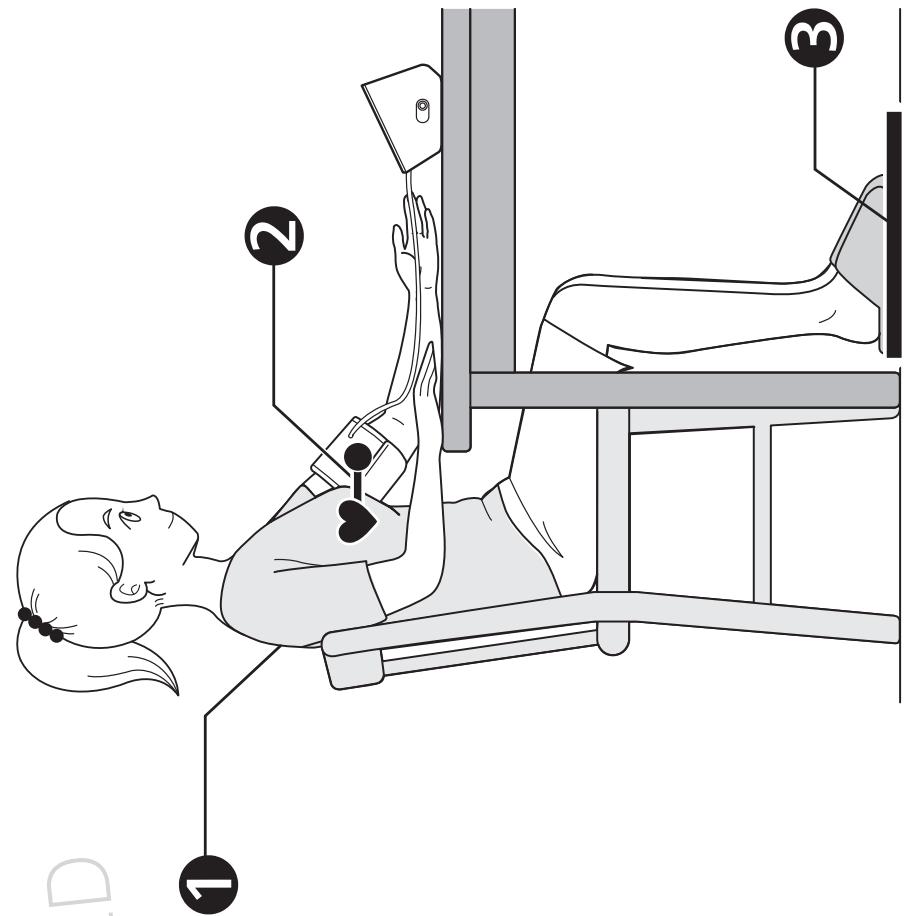

1 Sit comfortably with your back and arm supported.

- PL** Usiąść wygodnie, opierając plecy i ramię.
CZ Posadźcie się pohodlně, s opřenými zády a podepřenou rukou.
HU Üjjön le kényelmesen, a hátát és a karját támassza meg.
SK Sadnite si pohodlne tak, aby ste mali chrbát aj hornú končatinu podoprenú.
SL Pri sedenju naj bosta vaš hrbet in roka podprtia.
HR Sjednite u udoban položaj i neka su vam leđa i ruke poduprte.

2 Place the arm cuff at the same level as your heart.

- PL** Mankiet powinien znajdować się na wysokości serca.
CZ Umístěte manžetu v úrovni srdce.
HU A mandzsetta legyen a szívével azonos magasságban.
SK Manžetu umiestnite do rovnakej výšky ako máte srdce.
SL Manšeta za roko mora biti u višini vašega srca.
HR Stavite manžetu za ruku na razinu sa srcem.


3 Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.

- PL** Stopy ułożyć płasko na podłodze, nie krzyżować nóg, siedzieć spokojnie, bez ruchu i nie rozmawiać.
CZ Chodidla položte rovně, nohy nepřekřížujte, nehýbejte se a nemluvte.
HU Mindkét talpa legyen egyenes padlón, lábait ne tegye kereszbe, ne mozogjon és ne beszéljen.
SK Nohy majte vystreté, neprekrižené, nehýbte sa a nerozprávajte.
SL Stopala naj plosko počivajo na tleh, noge ne smejo biti prekrižane, mirujte in ne govorite.
HR Neka vam stopala budu ravno na podu, noge neprekrižene, ostanite mimi i ne govorite.

CELINE

9 Selecting User ID (1 or 2)

- PL** Wybór identyfikatora użytkownika (1 lub 2)
- CZ** Výber ID uživatele (1 nebo 2)
- HU** A felhasználói azonosító kiválasztása (1 vagy 2)
- SK** Výber ID používateľa (1 alebo 2)
- SL** Izbiranje ID-ja uporabnika (1 ali 2)
- HR** Odabir korisničke identifikacijske oznake (1 ili 2)

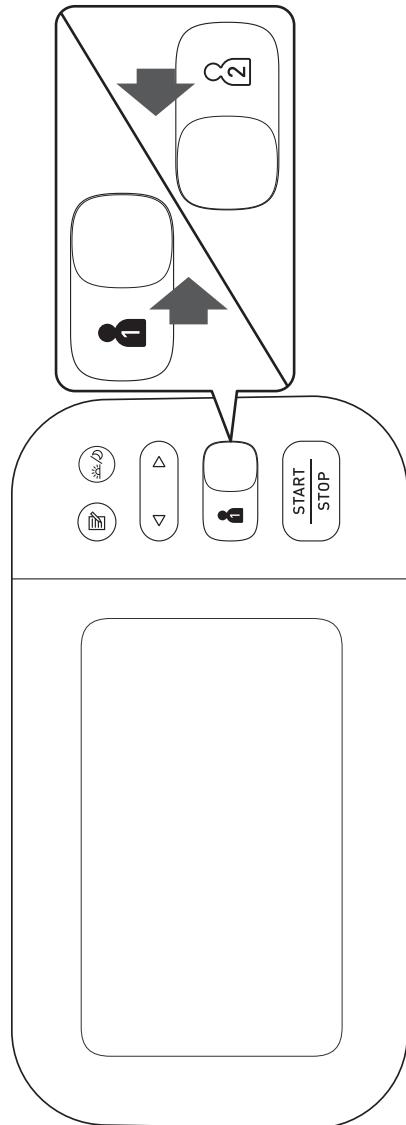

Switching user ID enables you to save readings for 2 people.

- PL** Przełączanie identyfikatora użytkownika umożliwia zapis odczytów dla 2 osób.
- CZ** Po přepnutí ID uživatele můžete uložit hodnoty pro 2 osoby.
- HU** A felhasználói azonosító kiválasztása lehetővé teszi, hogy 2 ember külön is elmenthesse a mérési eredményeket.
- SK** Prepnutie ID používateľa umožňuje ukladať namerané hodnoty pre 2 osoby.
- SL** Preklapljanje med dvema ID-jema uporabnikov omogoča shranjevanje meritve za 2 osebi.
- HR** Zamjenom korisničke identifikacijske oznake možete spremiti očitanja za dvije osobe.

10 Taking a Measurement


PL Wykonywanie pomiaru

CZ Měření

HU Mérés



SK Meranie tlaku krvi
SL Odčítavanje meritve
HR Mjerenje

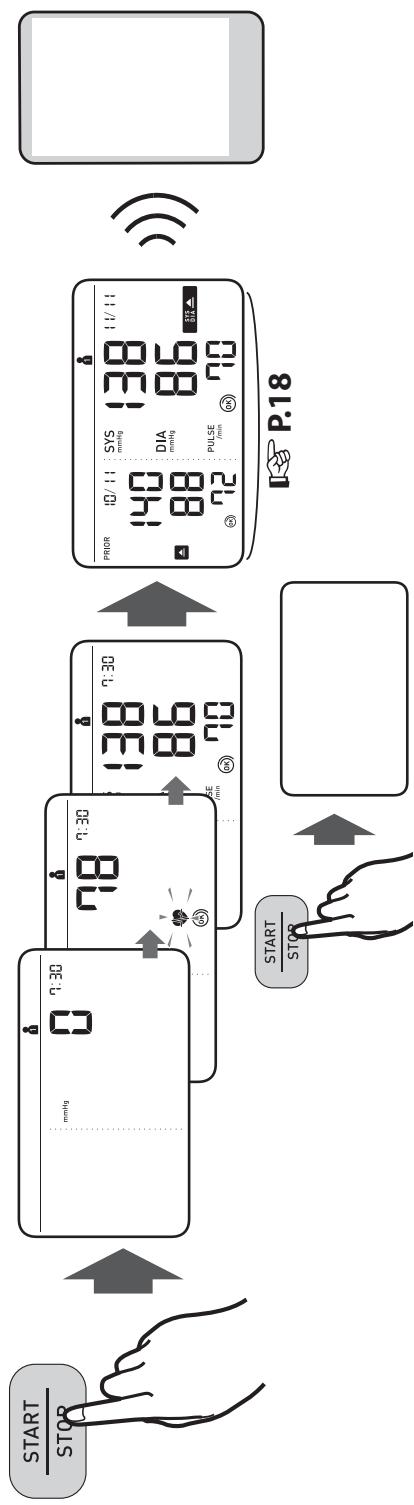

When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved automatically. Open the app to transfer the reading.

PL Po naciśnięciu przycisku [START/STOP] następuje pomiar i jego automatyczny zapis. Otwórzcie aplikację, aby przestać odczyt.


CZ Po stisknutí tlačítka [START/STOP] bude měření provedeno a uloženo automaticky. Otevřete aplikaci a spusťte přenos naměřených hodnot.

HU A [START/STOP] gomb megnyomásakor megkezdőlik a vérnyomásmérést, az eredményt pedig a készülék automatikusan elmenti. Nyissa meg az alkalmazást az eredmény továbbításához.

SK Po stlačení tlačidla [START/STOP] sa vykoná meranie a výsledok sa automaticky uloží. Otvorte aplikáciu, aby ste výsledok prenesli.

SL Ko pritisnete gumb [START/STOP], se meritev izvede in samodejno shrani. Odprite aplikacijo in prenesite odčítke.

HR Kada pritisnete gumb [START/STOP], izvodi se mjeritev i automatski se sprema. Otvorite aplikaciju radi prijenosa očitanja.

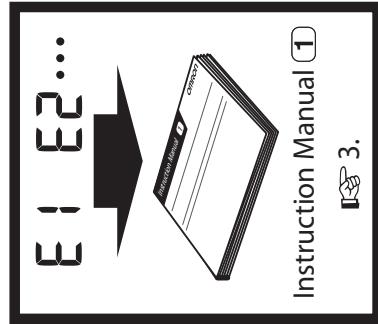

Taking a measurement in Afib mode

PL Pomiar w trybie Afib

CZ Měření v režimu Afib

HU Mérés Afib módban

In the Afib mode, your monitor automatically takes 3 consecutive readings at 30-second intervals and displays the average. If there is a possibility of atrial fibrillation (Afib), "Afib indicator symbol" (ⓘ) will appear. This is not a diagnosis, it is only a potential finding for Afib. You should contact your physician to discuss the findings. If you are experiencing any symptoms, contact a medical professional.

PL W trybie Afib ciśnieniomierz automatycznie dokonuje 3 kolejnych odczytów w 30-sekundowych odstępach, po czym wyświetla odczyt uśredniony. Jeżeli zachodzi możliwość występowania migotania przedsięnków (Afib), zostanie wyświetlony symbol „Afib” (ⓘ).

To nie jest rozpoznanie, to jest jedynie potencjalne wykrycie migotania przedsięnków. Skontaktować się z lekarzem w celu omówienia wyników pomiarów. W przypadku zaobserwowania objawów skontaktować się z lekarzem.

CZ V režimu Afib měří automaticky provede 3 po sobě následující měření ve 30sekundových intervalech a zobrazí průměrnou hodnotu. Pokud existuje možnost fibrilace síní (Afib), zobrazí se „symbol indikátoru Afib“ (ⓘ).

Nejdřív se o diagnózu, pouze o zjištění možné fibrilace síní. Obrátte se na lékaře a poradte se o zjištěném stavu. Pokud zaznamenáte jakékoli příznaky, obrátte se na lékařského odborníka.

HU Afib módban a vérnyomásmerő automatikusan 3 egymást követő mérést végez 30 másodperces időközönként, majd ezen mérések átlagát jeleníti meg. Ha pitvarfibrilláció (atrial fibrillation, Afib) lehetősége áll fenn, akkor az „Afib kijelzési szimbólum“ (ⓘ) fog megjelenni.

SK Meranie v režime predsieňovej fibrilácie

SL Izvajanje meritve v načinu Afib (atrijska fibrilacija)

HR Mjerjenje u načinu mjerenja za atrijsku fibrilaciju

Ez nem tekintható pontos orvosi diagnózisnak, csak a pitvarfibrilláció potenciális lehetőségét jelzi. Ezeket a visszajelzéseket mindenképpen beszélje meg orvosával. Ha bármilyen tünetet észzel, konzultáljon a megfelelő orvossal vagy szakértővel.



SK V režime predsieňovej fibrilácie merač automaticky vykoná 3 po sebe idúce merania v 30-sekundových intervaloch a zobrazi priemernú hodnotu. Ak existuje možnosť predsieňovej fibrilácie, zobraží sa symbol indikátora predsieňovej fibrilácie (ⓘ). Nejde o diagnózu, ale len o možnú zistenie predsieňovej fibrilácie. Zistenia by ste mali prekonzultovať so svojím lekárom. Ak ste zaznamenali akékoľvek príznaky, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka.

SL V načinu Afib meriliček samodejno opravi 3 zaporedne meritve s 30-sekundnim premorom in prikaže povprečni rezultat. Če obstaja verjetnost atrijske fibrilacije (Afib), se prikaže "simbol atrijske fibrilacije" (ⓘ).

To ni diagnoza, gre za morebitno ugotovitev pojava atrijske fibrilacije. O rezultatu meritve se obvezno posvetujte s svojim zdravnikom. Če opažate kakršne koli simptome, se obrnite na zdravstvenega strokovnjaka.

HR U načinu mjerjenja za atrijsku fibrilaciju vaš tlakomjer automatski izvodi tri uzastopna mjerjenja u razmacima od 30 sekundi i prikazuje prosječnu vrijednost. Ako postoji mogućnost atrijske fibrilacije (Afib), pojavit će se „pokazivač simbola Afib“ (ⓘ).

To nije dijagnoza, nego potencijalni nalaz atrijske fibrilacije. Treballi biste se obratiti svom liječniku da biste porazgovarali o nalazima. Ako imate bilo kakve simptome, obratite se medicinskom stručnjaku.

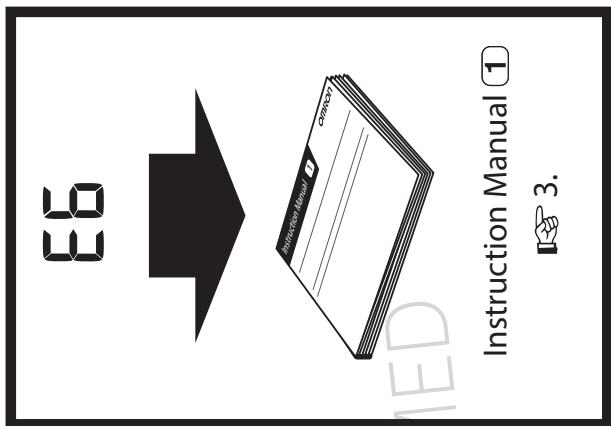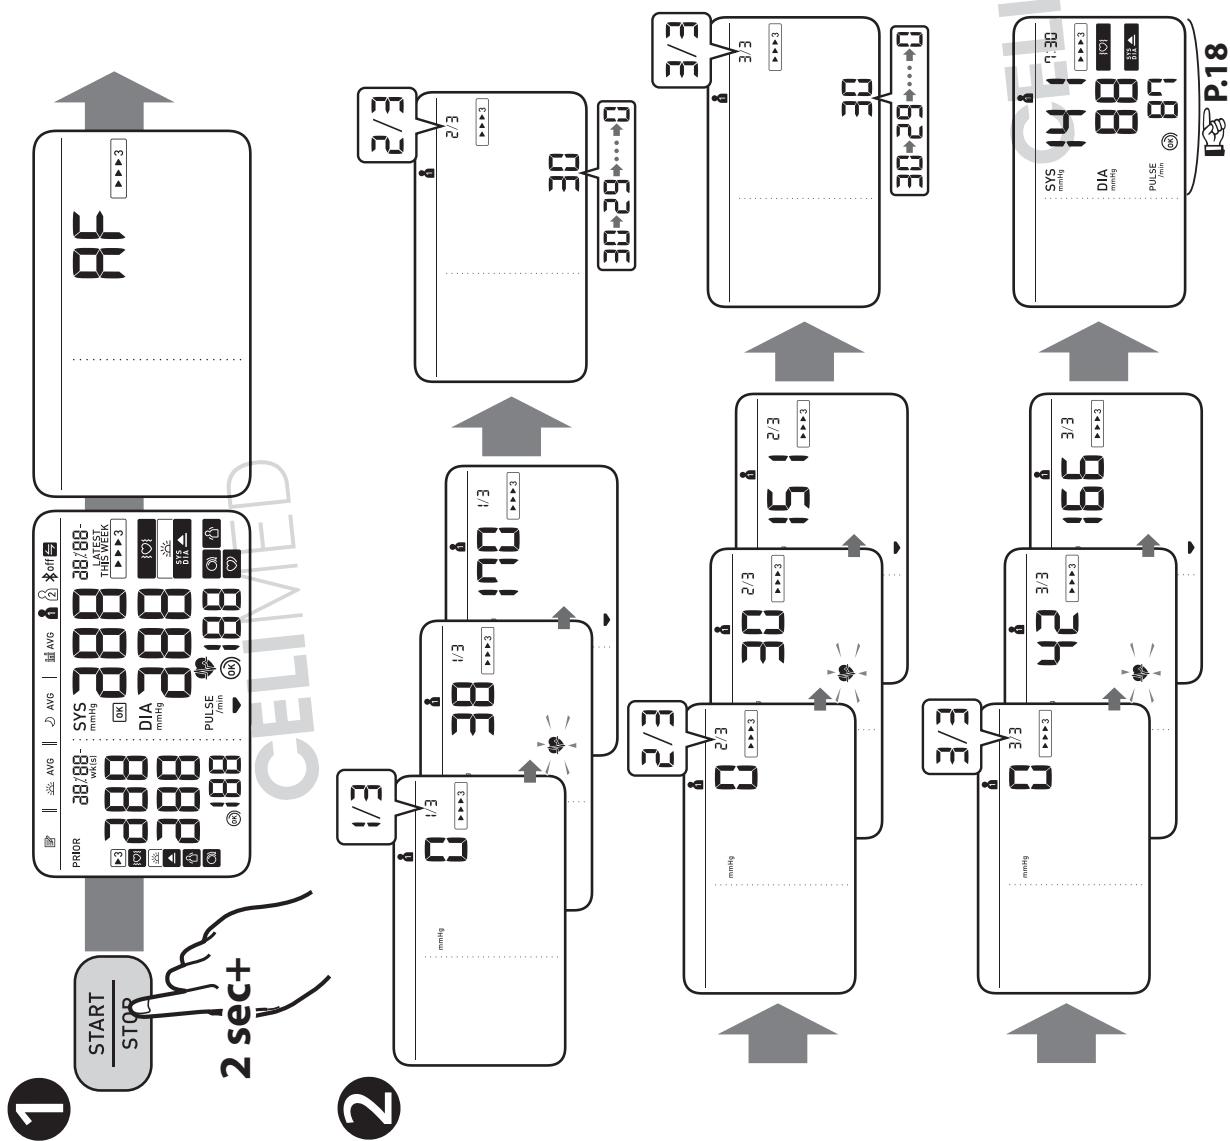

Taking a measurement in guest mode

PL Pomiar w trybie gościa

CZ Měření v režimu hosta

HU Mérés vendég üzemmódban

SK Meranie v režime hosta

SL Izvajanje meritve v načinu Gost

HR Mjerenje u načinu rada Gost

The guest mode can be used to take a single measurement for another user. No readings are stored in the memory, and the Afib mode is not available when the guest mode is selected.

PL Tryb gościa może być stosowany do wykonania pojedynczego pomiaru dla innego użytkownika. Po wybraniu trybu gościa odczyty nie są zapisywane w pamięci, a tryb Afib jest niedostępny.

CZ Režim hosta je možné použít k provedení jednoho měření u jiného uživatele. Pokud zvolíte režim hosta, nebudou v paměti uloženy žádné naměřené hodnoty a režim Afib nebude k dispozici.

HU A Vendég üzemmód arra használható, hogy más felhasználó is végezhessen egy mérést. Vendég üzemmódban a készülék a mérési eredményeket nem tárolja, és az Afib mód nem használható.

While holding the button down, press the [START/STOP] button.

PL Przytrzymując przycisk , naciśnij przycisk [START/STOP].

CZ Dřížte tlačítko stisknuté a současně stiskněte tlačítko [START/STOP].


HU Működésben a gombot lenyomva tartja, nyomja le a [START/STOP] gombot.

SK Držte stlačené tlačidlo a stlačte tlačidlo [START/STOP].

SL Medtem, ko držite gumb , pritisnite še gumb [START/STOP].

HR Dok držite pritisnutim gumb , pritisnite gumb [START/STOP].

2

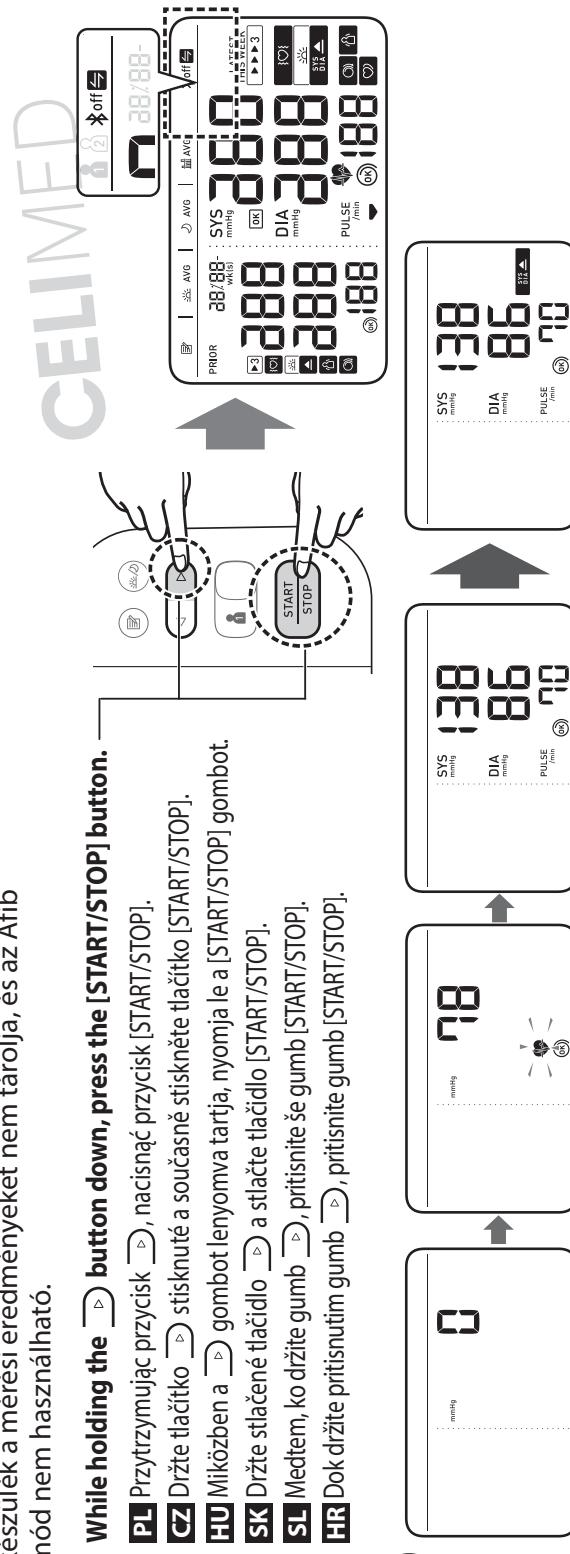

11 Checking Readings in Comparison Mode

PL Sprawdzanie odczytów w trybie porównawczym


SK Kontrola nameraných hodnôt v režime porovnávania

CZ Kontrola naměřených hodnot ve srovnávacím režimu

SL Primerjali pregled odčitkov

HU Eredmények ellenőrzése összehasonlító módban

HR Provjera očitanja u načinu usporedbe

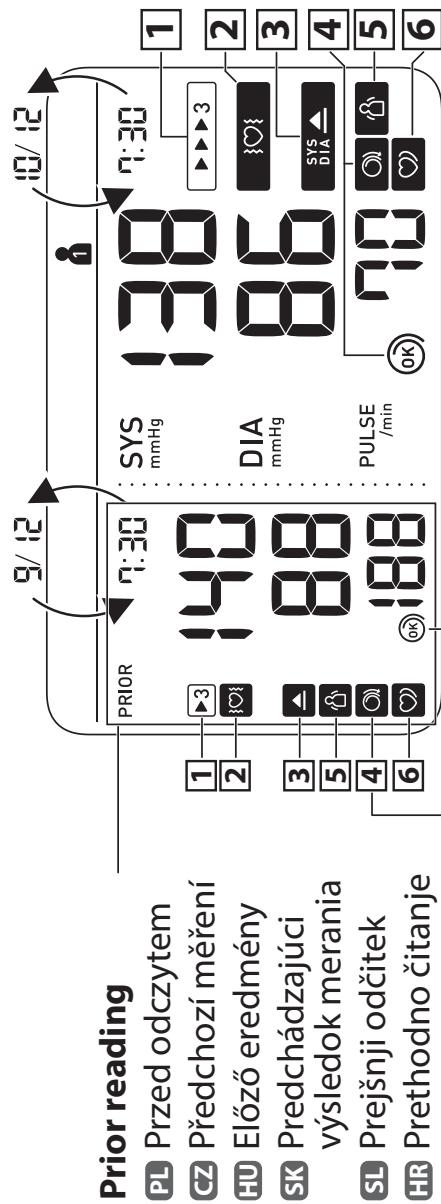

Appears when the reading was taken in Afib mode.

PL Pojawia się, gdy odczytu dokonano w trybie Afib.

CZ Zobrazí se, když bylo měření provedeno v režimu Afib.

HU Akkor jelenik meg, ha az eredményt a készülék Afib

módban tárolta.

SK Zobrazí sa, keď bola hodnota nameraná v režime predsieňovej fibrilácie.

SL Prikaže se, če ste meritev opravili v načinu Afib.

HR Pojavljuje se kad je očitanje izvedeno u načinu mijerenja za atrisku fibrilaciju.

<p>2  Appears if a possibility of Afib* was detected during the Afib mode measurement. If it continues to appear, we recommend you to consult with and follow the directions of your physician.</p> <p>PL Pojawia się, jeżeli wykryto możliwość wystąpienia migotania przedsiornków (Afib)* w czasie pomiaru w trybie Afib. Jeżeli stan ten utrzymuje się, zalecamy zasięgniecie porady lekarza i zastosowanie się do jego wskazówek.</p> <p>CZ Zobrazí se, pokud byla při měření v režimu Afib zjištěna možná fibrilace síní*. Pokud se indikátor i nadále objevuje, doporučujeme poradit se s vaším lékařem a následovat jeho pokyny.</p> <p>HU Akkor jelent meg, ha az Afib módban végzett mérés során pitvarfibrilláció* lehetősége merült fel. Ha ez a szimbólum rendszeresen megjelenik, akkor javasolt felkeresni orvosát és követni útmutatásait.</p>	<p>SK Zobrazí sa, ak bola počas merania v režime predsieňovej fibrilácie zistená možnosť predsieňovej fibrilácie*. Ak sa naďalej zobrazuje, odporúčame vám poradiť sa s lekárom a dodať jeho pokyny.</p> <p>SL Pojavi se, če je bila na podlagi načina Afib* ugotovljena verjetnost pojava atrijske fibrilacije. Če se ponavja, priporočamo, da se posvetujete s svojim zdravnikom in upoštevate njegova navodila.</p> <p>HR Pojavljuje se kad je prepoznata mogućnost atrijske fibrilacije* tijekom načina mjerenja za atrijsku fibrilaciju. Ako se nastavi pojavljivati, preporučujemo da se posavjetujete sa svojim liječnikom i držite se njegovih uputa.</p>
<p>3  Appears if "SYS" is 135 mmHg or above and/or "DIA" is 85 mmHg** or above.</p> <p>PL Pojawia się, jeżeli wartość SYS (ciśnienie skurczowe) wynosi 135 mmHg lub jest wyższa i/lub wartość DIA (ciśnienie rozkurczowe) wynosi 85 mmHg** lub jest wyższa.</p> <p>CZ Zobrazí se, pokud je hodnota „SYS“ 135 mmHg nebo wyższa a/nebo hodnota „DIA“ 85 mmHg** nebo wyższa.</p>	<p>HU Akkor jelent meg, ha a „SYS“ érték 135 Hgmm vagy magasabb, és/vagy a „DIA“ érték 85 Hgmm** vagy magasabb.</p> <p>SK Zobrazí sa, ak „SYS“ má hodnotu 135 mmHg alebo vyššiu a/alebo „DIA“ má hodnotu 85 mmHg*** alebo viac.</p> <p>SL Prikaže se, če je „SYS“ (sistolični tlak) 135 mmHg ali višji in/ali „DIA“ (diastolični tlak) 85 mmHg*** ali višji.</p> <p>HR Pojavljuje se ako je „SYS“ 135 mmHg ili viši i/ili je „DIA“ 85 mmHg*** ili viši.</p>
<p>4  Cuff is tight enough.</p> <p>PL Mankiet jest wystarczająco ciasno założony.</p> <p>CZ Manžeta je dostatečně utažená.</p> <p>HU A mandzsetta elég szorosan van felhelyezve.</p> <p>SK Manžeta nie je dostatočne utiahnutá.</p> <p>SL Manžeta je nameščena dovolj tesno.</p> <p>HR Manžeta je dovoljno stegnuta.</p>	<p>4  Apply cuff again MORE TIGHTLY.</p> <p>PL Założyć mankiet ponownie, MOCNIEJ zaciskając.</p> <p>CZ Nasadte manžetu znova a UTÁHNĚTE JI PEVNĚJI.</p> <p>HU Rögzítse SZOROSABBAN a mandzsettát.</p> <p>SK Znova nasadte manžetu, tentokrát PEVNEJŠIE.</p> <p>SL TESNEJE namestite manžeto.</p> <p>HR Ponovo stavite manžetu i STEGNITE JE JAČE.</p>

5 Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm cuff, wait 2-3 minutes and try again.

(The body movement function is disabled when the possibility of Afib or irregular heartbeat is detected during a Afib mode measurement.)

PL Pojawia się w przypadku wykrycia ruchów ciała podczas pomiaru. Zdjąć mankiet, poczekać 2–3 minuty i spróbować ponownie.

(Funkcja wykrywania ruchów ciała jest wyłączona, jeżeli w czasie pomiaru w trybie Afib wykryto możliwość wystąpienia migotania przedsiornków (Afib) lub arytmii).

CZ Zobrazí se, pokud se vaše tělo během měření pohné.

Sejměte manžetu, výčkejte 2–3 minuty a postup opakujte. (Funkce detekce pohybu těla je deaktivována, když je zjištěna možná fibrilace srdí nebo nepravidelného srdečního rytmu při měření v režimu Afib.)

HU Akkor jelentik meg, ha a mérés közben a mozog. Vegye le a mandzsettát, vártson 2-3 percig, majd próbálja újra a mérést.

(A test mozgását észlelő funkció le van tiltva, ha Afib módban végzett mérés közben a készülék pitvarfibrilláció lehetőségét vagy szabálytalan szívverést érzékel.)



SK Zobrazi sa, keď sa vaše telo počas merania hýbe. Odstráňte manžetu, počkajte 2 až 3 minúty a skúste to znova.

(Funkcia pohybu tela je zakázaná, keď sa počas merania v režime predsieňovej fibrilácie zistí predsieňová fibrilácia alebo nepravidelný srdcový rytmus.)

SL Prikaže se, če se med meritvijo premikate. Odstranite manšeto za roko, počakajte 2-3 minute in poskusite znova.

(Funkcija zaznavanja premikanja telesa se onemogoči, če merilnik med merjenjem v načinu Afib zazna neenakomeren srčni utrip ali možno atrijsko fibrilacijo.)

HR Pojavljuje se kada se vaše tijelo miče tijekom mjerjenja. Skinite manžetu za ruku, pričekajte dvije do tri minute i pokušajte ponovo.

(Funkcija micanja tijela onemogućena je kad je tijekom načina mjerjenja za atrijsku fibrilaciju prepoznata mogućnost atrijske fibrilacije ili nepravilnog srčanog ritma.)

6 Appears when an irregular rhythm* is detected during a measurement. If it continues to appear, it is recommended to consult your physician. (It does not appear during a Afib mode measurement)



PL Pojawia się, gdy w czasie pomiaru wykryto arytmię*. Jeżeli nadal będzie widoczny, zaleca się konsultację z lekarzem. (Nie wyświetla się w czasie pomiaru w trybie Afib.)

SK Zobrazí sa, keď sa počas merania zistí nepravidelný rytmus*. Ak sa zobrazuje nadalej, odporúčame poradiť sa s lekárom.

(Nezobrazuje sa počas merania v režime predsieňovej fibrilácie) **SL** Prikaže se, če merilnik zazna neenakomeren* srčni utrip. Če prikaz ne izgine, se posvetujte s svojim zdravnikom. (Ikona se ne prikaže, če meritev izvajate v načinu Afib.)

HR Pojavljuje se kada se tijekom mjerjenja prepozna nepravilan srčani ritam*. Ako se nastavi pojavljivati, preporučujemo da se posavjetujete sa svojim liječnikom. (Ne pojavljuje se tijekom načina mjerjenja za atrijsku fibrilaciju)

HU Akkor jelentik meg, ha a készülék a mérés közben szabálytalan szívverést* érzékel. Mindenképpen konzultájlon orvosával, ha ez a jelzés többször is megjelenik.

(Ez a jelzés nem jelentik meg Afib módban végzett mérések soiran)

CELMED

* Afib and an irregular heartbeat rhythm are defined as a rhythm that is 25 % less or 25 % more than the average rhythm detected while your monitor is measuring blood pressure. The difference between the Afib indicator function and irregular heartbeat function is:

Afib indicator function: detects Afib possibility in 3-times measurement.
Irregular heartbeat function: detects irregular heartbeat including Afib in 1 measurement.

PL * Migotanie przedsionków i arytmie określa się jako stan, w którym rytm uderzeń serca jest o 25 % wolniejszy lub o 25 % szybszy od średniej częstotliwości rytmu serca zarejestrowanej podczas pomiaru ciśnienia krwi. Różnica pomiędzy funkcją wskazywania migotania przedsionków (Afib) a funkcją wykrywania arytmii:

Funkcja wskazywania migotania przedsionków (Afib) wykrywa możliwość wystąpienia Afib w trakcie 3 kolejnych pomiarów.

Funkcja wykrywania arytmii: wykrywa nieregularny rytm pracy serca, w tym migotanie przedsionków, w czasie 1 pomiaru.

CZ * Fibrilace síní a nepravidelný srdeční rytmus jsou definovány jako rytmus, který má o 25 % nižší nebo o 25 % vyšší hodnotu než průměrný rytmus naměřený přístrojem během měření krevního tlaku. Rozdíl mezi funkcí indikátoru fibrilace síní a funkcí nepravidelné srdeční činnosti je následující:

Funkce indikátoru Afib: Zjišťuje možnou fibrilaci síní při 3krát opakováném měření.

Funkce nepravidelné srdeční činnosti: Zjišťuje nepravidelný srdeční rytmus včetně fibrilace síní při 1 měření.

HU * Az Afib és a szabálytalan szívverés olyan ritmust jelent, amely 25%-kal kevesebb vagy 25%-kal több a készülék által a vérnyomás mérésére során észlelt átlagos szívritmusnál. Az Afib visszajelző funkció és a szabálytalan szívverés funkció közötti különbség: Afib visszajelző funkció: a pitvarfibrilláció lehetőséget 3 mérésből álló sorozatban érzékeli.

Szabálytalan szívverés funkció: a szabálytalan szívverést, beleértve a pitvarfibrillációt lehetőséget is, 1 mérés során érzékeli.

SK * Predstehová fibrilácia a nepravidelný srdcový rytmus sú definované ako rytmus, ktorý je o 25 % nižší alebo o 25 % vyšší ako priemerný pulz zistený zariadením pri meraní krvného tlaku. Rozdiel medzi funkciou indikátora predstehovej fibrilácie a funkciou nepravidelného srdcového rytmu je nasledovný:

funkcia indikátora predstehovej fibrilácie rozpoznáva možnosť predstehovej fibrilácie v meraní pozostávajúcim z troch merani. Funkcia nepravidelného srdcového rytmu: rozpoznáva nepravidelný srdcový rytmus vrátane predstehovej fibrilácie v jednom meraní.

SL * Atrijalna fibrilacija in neenakomerno bitje srca sta definirana kot ritem, ki je za 25 % večji ali za 25 % manjši od povprečnega ritma, ki je zaznan, ko merilnik meri krvni tlak. Razlika med funkcijo prikaza morebitne atrijalne fibrilacije in funkcijo prikaza neenakomernega srčnega utrija:

za funkcijo prikaza morebitne atrijalne fibrilacije mora merilnik opraviti 3 zaporedne meritve.

Neenakomeren srčni utrip: zaznavanje nepravilnosti v srčnem utriju, vključno s posameznimi meritvami atrijalne fibrilacije.

HR * Atrijalna fibrilacija i nepravilan srčani ritam definiraju se kao ritam koji je za 25 % manji ili za 25 % večji od prosječnog ritma koji tlakomjer prepoznaže kod mjerjenja krvnog tlaka. Razlika između funkcije pokazivača simbola Afib i funkcije nepravilnog srčanog ritma: Funkcija pokazivača simbola Afib: prepoznaće mogućnost atrijalne fibrilacije tijekom triju mjerjenja.

Funkcija nepravilnog srčanog ritma: prepoznaće nepravilan srčani ritam ukљučujući Afib u jednom mjerenuju.

**** The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.**

PL ** Definicję wysokiego ciśnienia krwi oparto na wytycznych 2018 ESH/ESC.

CZ ** Definice vysokého krevního tlaku je založena na doporučených postupech 2018 ESH/ESC.

HU ** A magas vérnyomás definíciója a 2018 ESH/ESC útmutatásai alapján került meghatározásra.

SK ** Definícia vysokého krvného tlaku je založená na usmerneniach ESH/ESC na rok 2018.

SL ** Visok krvni tlak je opredelen po smernicah 2018 ESH/ESC.

HR ** Definicija visokog krvnog tlaka temelji se na smjernicama 2018 ESH/ESC.

CELI MED

Error messages or other problems? Refer to:

E1

PL Komunikaty o błędzie lub innym problemie?
Przejdz do:

E2

CZ Vyskytla se chybová hlášení či jiné
problemy? Přečtěte si:

HU Hibaiüzeneteket lát vagy egyéb
problémákat merültek fel? Lásd:

•

SK Chybové hlásenia alebo iné problémy?
Porrite si:

SL Sporočila o napakah ali druge težave?
glejte:

HR Poruke o pogreškama ili drugi problemi?
Pogledajte:



Instruction Manual **(1)**
 3.

12 Using Memory Functions

PL Korzystanie z funkcji pamięci

CZ Použití funkcí paměti

HU A memóriafunkciók használata

SK Používanie funkcie pamäte

SL Uporaba funkcij pomnilnika

HR Upotreba memorijske funkcije

Before using memory functions, select your user ID.

PL Przed skorzystaniem z funkcji pamięci należy wybrać swój identyfikator użytkownika.


CZ Před použitím funkcií paměti vyberte ID uživatele.

HU A memóriafunkciók használata előtt ki kell választania a felhasználói azonosítót.

SK Pred použitím funkcií pamäti pamäti vyberte svoje ID používateľa.

SL Za uporabo funkcij pomnilnika morate najprej izbrati svoj ID uporabnika.

HR Prije upotrebe memorijske funkcije odaberite korisničku identifikacijsku oznaku.

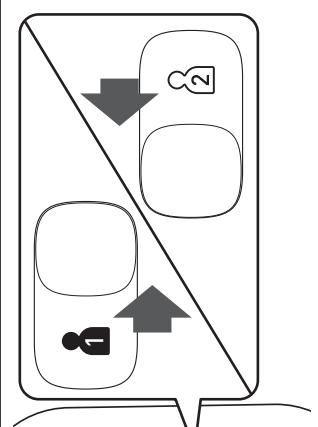

12.1 Readings Stored in Memory

PL Odczyty zapisane w pamięci

CZ Hodnoty uložené v paměti

HU A memóriában tárolt értékek

SK Namerané výsledky uložené v pamäti

SL Odčitki, shranjeni v pomnilniku

HR Mjerenja pohranjena u nemoniju


Stores up to 100 readings. **SK** Ukladá až 100 výsledkov merania.

PL Zapis do 100 odczytów.


CZ Ukládá až 100 naměřených hodnot.

HU Maximum 100 eredményt.

HR Pohranjuje do 100 očitanja.

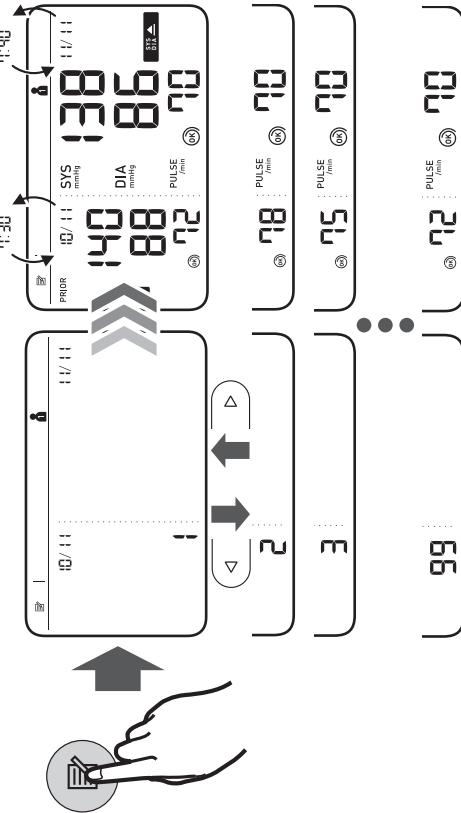

Morning/Evening Weekly Averages

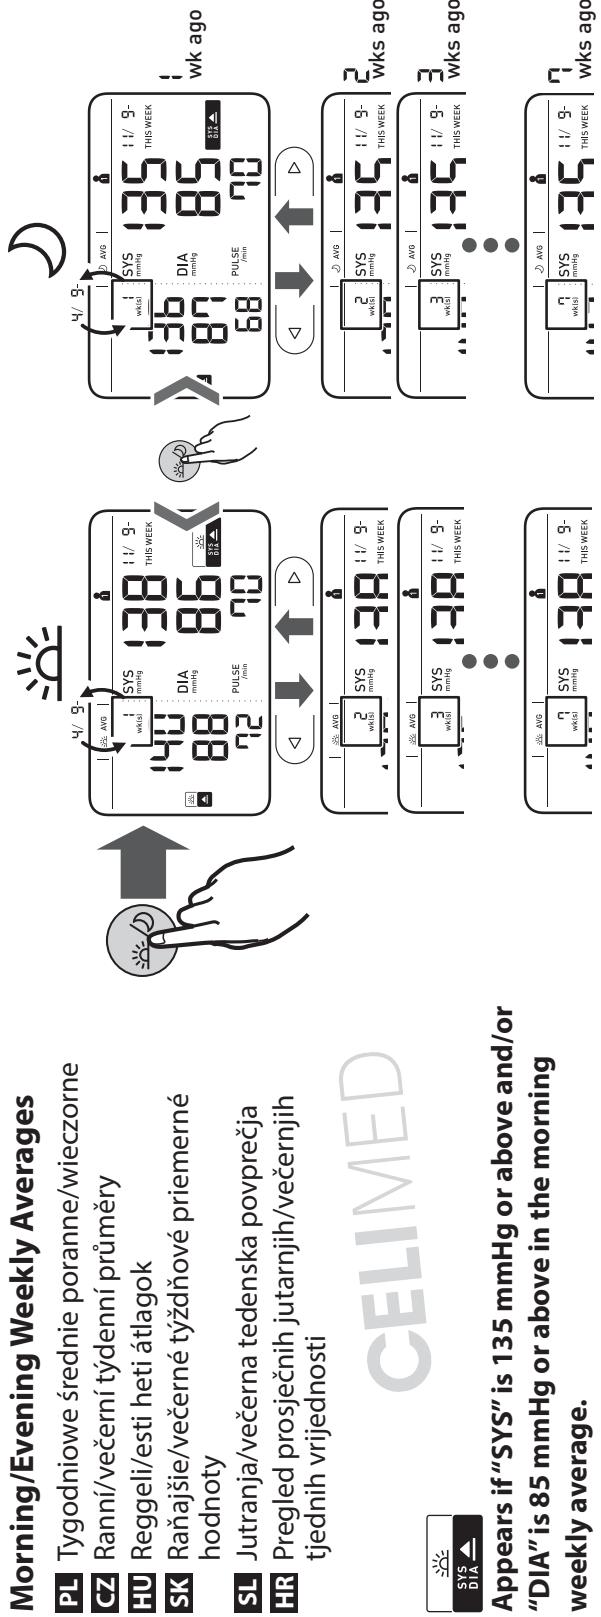

PL Tygodniowe średnie poranne/wieczorne

CZ Ranní/večerní týdenní průměry

HU Reggel/estí heti átlagok

SK Raňajšie/večerné týždňové priemerné hodnoty

SL Jutranja/večerna tedenska povprečja

HR Pregled prosječnih jutarnjih/večernjih tjednih vrijednosti

CELIMED



Appears if "SYS" is 135 mmHg or above and/or "DIA" is 85 mmHg or above in the morning weekly average.

PL Pojawia się, jeżeli wartość SYS (ciśnienie skurczowe) wynosi 135 mmHg lub jest wyższa i/lub wartość DIA (ciśnienie rozkurczowe) wynosi 85 mmHg lub jest wyższa w przypadku tygodniowej średniej porannej.

CZ Zobrazí se, pokud je ranní týdenní průměr hodnot „SYS“ 135 mmHg nebo vyšší a/nebo pokud je ranní týdenní průměr hodnot „DIA“ 85 mmHg nebo vyšší.

HU Akkor jelenik meg, ha a „SYS“ érték 135 Hgmm vagy magasabb, és/vagy a „DIA“ érték 85 Hgmm vagy magasabb a reggeli heti átlagok értékeiben.

SK Zobrazí sa, ak „SYS“ má hodnotu 135 mmHg alebo vyššiu a/alebo „DIA“ má hodnotu 85 mmHg alebo viac v rāňajšom týždennom priemere.

SL Prikaže se, če je "SYS" (sistolični tlak) 135 mmHg ali višji in/ali "DIA" (diastolični tlak) 85 mmHg ali višji.

HR Pojavljuje se ako je „SYS“ 135 mmHg ili viši ili ako je „DIA“ 85 mmHg ili viši u prosječnoj jutarnjoj tijednoj vrijednosti.

To know how to calculate weekly averages, refer to section 10 of the Instruction Manual ①.

PL Informacje o sposobie obliczania średnich tygodniowych podano w punkcie 10 niniejszej instrukcji obsługi ①.

CZ Postup výpočtu týdenních průměrů naleznete v kapitole 10 Návodu k obsluze ①.

HU A heti átlagok kiszámításával kapcsolatos részletekért lásd a Használati útmutató ① 10. fejezetet.

SK Ak sa chcete dozvedieť, ako vypočítať týždenné priemery, pozrite si časť 10 návodu na obsluhu ①.


SL Pojasnila o izračunu tedenških povprečij najdete v 10. poglavju priročnika z navodili ①.

HR Pogledajte 10. odjeljak u priročniku s uputama da biste naučili kako izračunati tjedne prosječne vrijednosti ①.

CELIMED


12.3 Average of the Latest 2 or 3 Readings Taken within a 10 Minute Span

- PL** Šrednia z ostatnich 2 lub 3 odczytów dokonanych w odstępie 10 minut
CZ Průměr z posledních 2 nebo 3 měření provedených v rozmezí 10 minut
HU 10 perces intervallumban végezett mérésök között az utolsó 2 vagy 3 mérés átlaga
SK Priemer posledných 2 alebo 3 výsledkov meraní za časové obdobie 10 minút
SI Povprečje zadnjih 2 ali 3 meritev v 10-minutnem časovne obdobju
HR Prosječna vrijednost posljednjih dvaju ili triju očitanja izvedenih u razmaku od 10 minuta

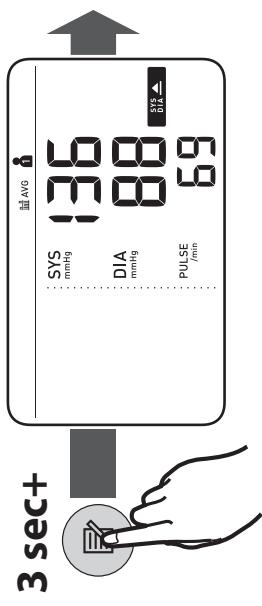**3 sec+**

12.4 Deleting All Readings for 1 User

- PL** Usuwanie wszystkich odczytów dotyczących 1 użytkownika
CZ Smazání všech naměřených hodnot pro 1 uživatele
HU Az 1. számú felhasználó összes mérésénél törlése

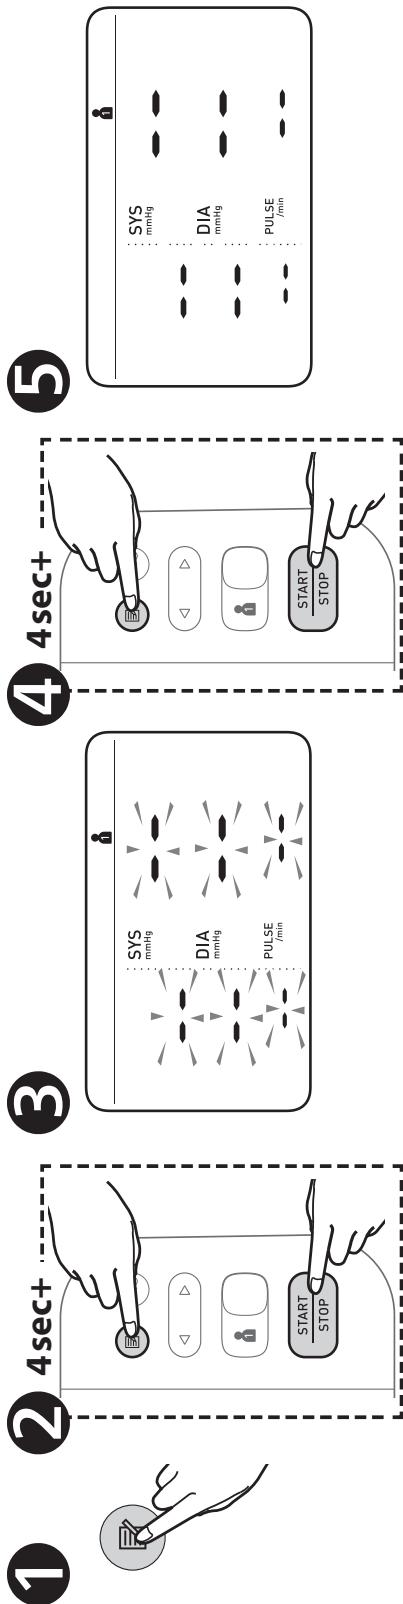


13 Other Settings

- PL** Inne ustawienia
- CZ** Další nastavení
- HU** Egyéb beállítások
- SK** Ďalšie nastavenia
- SL** Druge nastavivte
- HR** Ostale postavke

13.1 Disabling/Enabling Bluetooth

- PL** Włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth
- CZ** Vypnutí/zapnutí funkce Bluetooth
- HU** Bluetooth kikapcsolása/engedélyezése
- SK** Deaktivácia/aktivácia rozhrania Bluetooth
- SL** Omogočanje/onemogočavanje povezave Bluetooth
- HR** Omogućavanje/onemogućavanje značajke Bluetooth

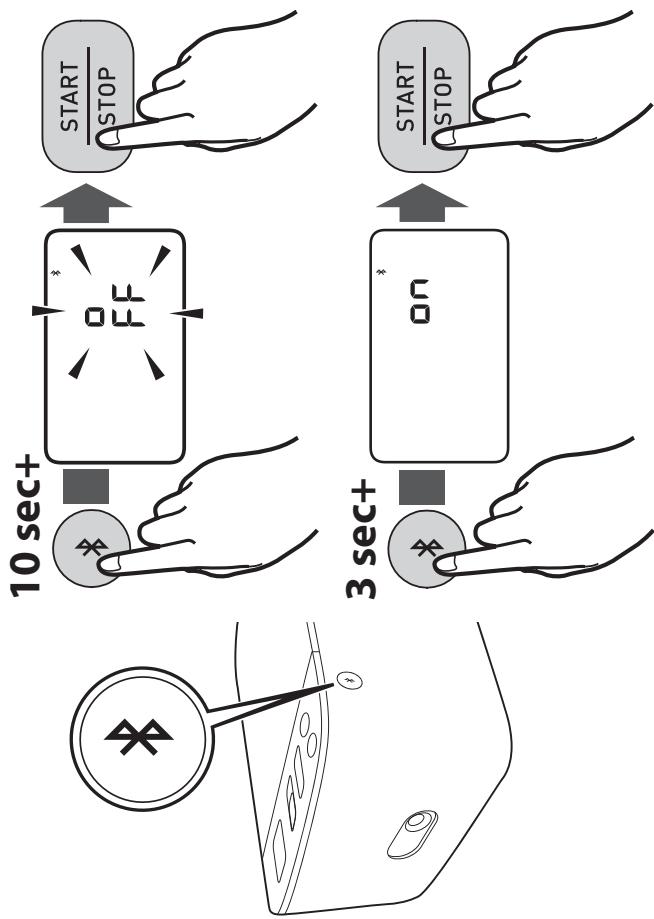

Bluetooth is enabled by default.

PL Funkcja Bluetooth jest domyślnie włączona.

CZ Ve výchozím nastavení je funkce Bluetooth zapnuta.

HU Az alapértelmezett beállítás szerint a Bluetooth engedélyezett.

SK Rozhranie Bluetooth je predvolene aktivované.

SL Povezava Bluetooth je privzetno omogočena.

HR Značajka Bluetooth omogućena je kao zadana postavka.

CELI MED


13.2 Restoring to the Default Settings

PL Przywracanie ustawień domyślnych

CZ Obnovení výchozích nastavení

HU Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz

- SK** Obnova predvolených nastavení
- SL** Obnovitev prvotnih nastavitev
- HR** Vraćanje na zadane postavke

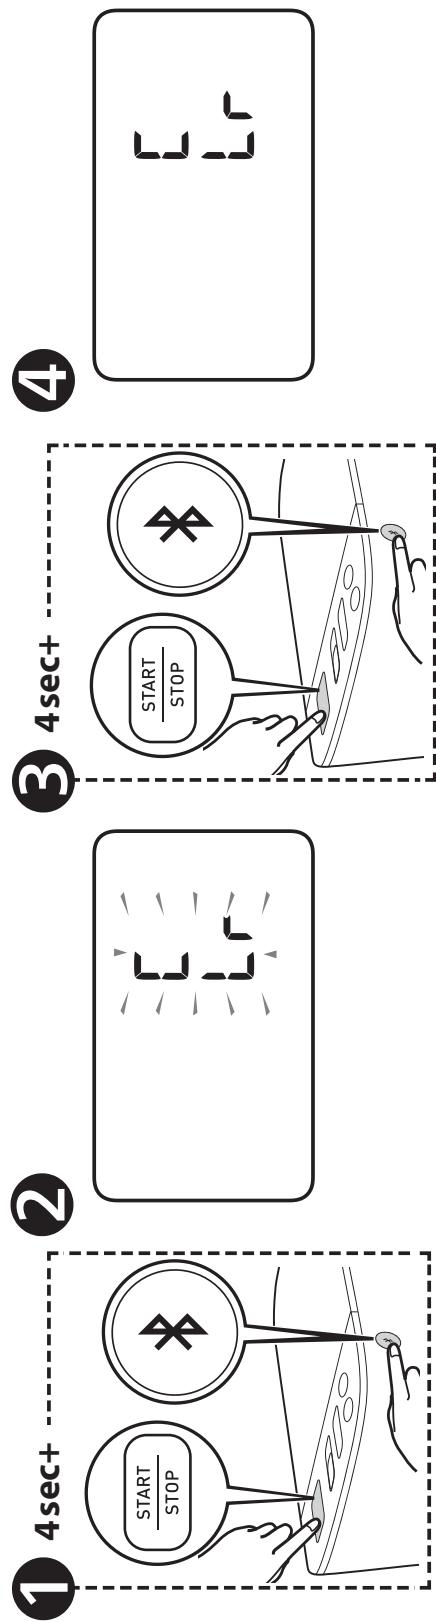

CELIMED

**If your systolic pressure is more than 210 mmHg:
After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.**

PL Ješli ciśnienie skurczowe jest wyższe niż 210 mmHg

Po rozpoczęciu napełniania mankietu naciśnij i przytrzymaj przycisk [START/STOP], aż ciśnieniomierz napompuje mankiet do wartości o 30–40 mmHg wyższej od przewidywanego ciśnienia skurczowego.

CZ Je-li váš systolický tlak vyšší než 210 mmHg:

Jakmile se manžeta začne nafukovat, stiskněte a přidržte tláčítka [START/STOP], dokud se přístroj nenaťukne o 30 až 40 mmHg více, než je váš očekávaný systolický tlak.

HU Ha a szisztoles vérnyomás értéke 210 Hgmm-nél magasabb:

Miután megkezdődött a mandzsetta felfüvása, nyomja meg és tartsa lenyomva a [START/STOP] gombot, amíg a készülék a vártszisztoles vérnyomást 30–40 Hgmm-rel meg nem haladjá.

SK Ak máte systolický tlak vyšší než 210 mmHg:

Ked' sa začne manžeta nafukovať, pridržte stačené tláčidlo [START/STOP] dovtedy, kým merač nenaťukne manžetu na tlak o 30 až 40 mmHg vyšší, než je váš očakávaný systolický tlak.

SL Če vaš sistolični tlak preseg 210 mmHg:

Ko se začne manžeta za roko napihovati, pritisnite in držite gumb [START/STOP], dokler merilnik manšete ne napihne za od 30 do 40 mmHg nad vašim pričakovanim sistoličnim tlakom.

HR Ako je vaš sistolički tlak viši od 210 mmHg:

Kad se manžeta počne napuhavati, pritisnite i držite gumb [START/STOP] dok se uređaj ne napiše na 30 do 40 mmHg više od očekivanog sistoličkog tlaka.

14 Optional Medical Accessories

PL Opcjonalne akcesoria medyczne


CZ Volitelné zdravotnické příslušenství

HU Opcionális orvosi alkatrészek

SK Voliteľné zdravotnícke príslušenstvo

SL Izbirni medicinski pripomočki

HR Opcijska dodatna medicinska oprema

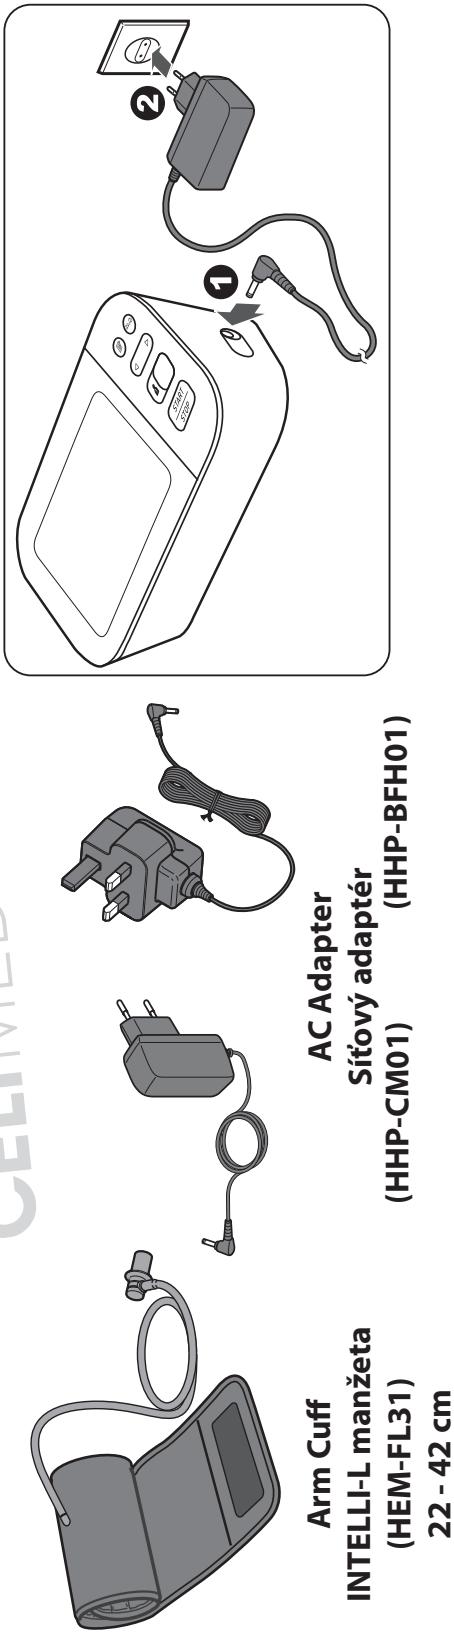

Arm Cuff
INTELLI-L manžeta
(HEM-FL31)
22 - 42 cm

AC Adapter
Síťový adaptér
(HHP-CM01)

Do not throw the air plug away. The air plug can be applicable to the optional cuff.

PL Nie wyrzucać wtyczki przewodu powietrza. Wtyczkę przewodu powietrza można podłączyć do opcjonalnego mankietu.

CZ Vzduchovou zástrčku nevyhazujte. Vzduchovú zástrčku lze použít na volitelnou manžetu.

HU Ne dobja el a levegőcsatlakozót. A levegőcsatlakozó az opcionális mandzsettához használható.

SK Vzduchovú zástrčku neodhadzujte. Vzduchovú zástrčku možno použiť s voliteľnou manžetou.

SL Ne zavrzite zračnega vtiča. Zračni vtič se lahko uporablja za dodatno manžeto.

HR Ne bacajte čep za zrak. Čep za zrak može biti primjenjiv za neobaveznu manžetu.

CELI MED


15 Other Optional Parts

- PL** Inne części opcjonalne
- CZ** Další volitelné díly
- HU** További opcionális alkatrészek

SK Ďalšie voliteľné súčasti

SL Drugi izbirni deli

HR Drugi neobavezni dijelovi

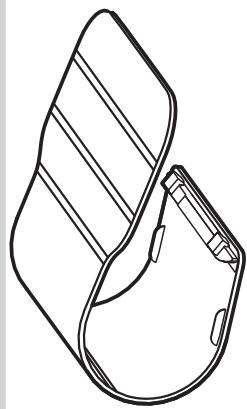

Protective LCD Cover
(HEM-CACO-734)

<https://www.omron-healthcare.com/>

CELIMED

	Manufacturer Producent Výrobce	Gyártó Výrobca	Proizvajalec Proizvođač	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
EC REP EU-representative	Przedstawiciel handlowy w UE Zastupce pro EU EU-képviselő	Zastúpenie v EÚ EU predstavník Predstavníšťvo u Europskoj uniji	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com	
Importer in EU Importer na obszarze Unii Europejskiej	Dovozed do EU EU importör Dovozca do EU	Uvoznič v EU Uvozník za područje Evropske unije		
Production facility Siedziba produkcji Výrobní závod	Termékképviselő Výrobná prevádzka	Proizvodni obrat Proizvodni pogon	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam	
Subsidiaries Filie Pobočky	Leányvállalatok Dcérske spoločnosti	Podružnice Podružnice	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, GERMANY www.omron-healthcare.com	
			OMRON SANTÉ FRANCE SAS 3, Parvis de la Gare, 94130 Nogent-sur-Marne, FRANCE N° Vert 0 800 91 43 14 www.omron-healthcare.com	
CZ	Distribuce a servis pro ČR a metrologické ověření pro lékařské zařízení		CELIMED s.r.o. Sociální péče 3487/5a, 40011 Ústí nad Labem pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz	

Issue Date / Data publikacji / Datum vydání / Kiadás dátuma / Dátum vydania / Izdanø / Datum izdavanja: 2019-10-15